



RHEIN83
THE DENTAL ATTACHMENTS COMPANY



MANUAL TECNICO ILUSTRATIVO |
PRÓTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
para odontólogos y protésicos dentales



Rhein83 se fundó en Bolonia en 1983 y estableció su sede y centro de producción en Bolonia. Más de 30 empleados trabajan con pasión y dedicación, llevando a la empresa a convertirse en líder del mercado en Italia y exportando con éxito a más de 100 países. Un centro de formación, la Academia Rhein83, acoge a odontólogos y protésicos dentales de todo el mundo, ofreciendo un amplio programa de cursos dedicados a las prótesis removibles y fijas sobre ataches.



Los ataches de bolas ya existían desde hacía muchos años: una bola de metal y un capuchón de retención, también de metal. Pero estos accesorios no encontraban ni el favor ni el mercado. De ahí la intuición de hacer elástico el mecanismo, aplandar la cabeza de la bola y construir un capuchón de plástico. La idea fue un éxito y hoy en día esta técnica es una de las más utilizadas. Rhein83 existe desde 1983 y sus productos tienen varias copias en todo el mundo, copias que en muchos casos reflejan las formas de los objetos pero no los materiales de los que están hechos, por lo que el resultado funcional cambia significativamente. La investigación se dedica al estudio de nuevos productos, pero también a perfeccionar constantemente el funcionamiento de los que se utilizan desde hace años. Los brackets dentales son pequeños mecanismos en constante movimiento y sometidos a esfuerzos impredecibles, por lo que es necesario mantenerlos y actualizarlos. Algunos de los productos del catálogo

están hechos para mantener y restaurar la funcionalidad, en todas las prótesis, si es necesario directamente en la boca de los pacientes. El compromiso de Rhein83, con su experiencia continuamente enriquecida por colaboraciones externas con odontólogos y protésicos dentales, es mejorar los estándares actuales y desarrollar nuevos productos mediante diseños originales.

Ezio Nardi
(fundador)

¡Llevamos cuarenta años escribiendo juntos el futuro!



Producción



Rhein83 fabrica en la sede de Bolonia. El taller interno produce componentes para muchos fabricantes de implantes y piezas personalizadas a petición.

Asistencia técnica



Los protésicos dentales del laboratorio interno ofrecen asesoramiento técnico por teléfono y organizan cursos gratuitos presenciales y en línea.

Oficinas



Un equipo joven y competente responde diariamente a los clientes italianos y extranjeros ofreciendo asesoramiento para cada necesidad.

Almacenamiento y envasado



El almacén está siempre a disposición de los clientes, pudiendo despachar los productos en muy poco tiempo.

Formación científico



Se proponen diferentes enfoques de la odontología y odontología, desde las técnicas tradicionales hasta las más avanzadas soluciones digitales.

Cursos En directo



El proceso quirúrgico protésico en todas sus fases, una excelente herramienta para facilitar el aprendizaje de nuevos protocolos.

Investigación y Desarrollo



La innovación y la investigación se desarrollan con la colaboración de numerosas universidades tanto italianas como extranjeras

Academia Rhein83



Conferencias, eventos y cursos prácticos, que acogen a profesionales de todo el mundo para formarse en prótesis fija y prótesis removibles.



Ver calendario
Cursos Rhein83



Consultar la literatura
científica Rhein83



Ver videos
Clínica Rhein83

Rhein83	<i>La empresa</i>	Pág. 2
	<i>40 años juntos</i>	Pág. 3
	<i>Formación</i>	Pág. 4
Índice		Pág. 5
Ot Equator	<i>Un pilar para todo tipo de prótesis sobre implantes</i>	Pág. 6
	<i>Ot Equator Easy Fix: La prótesis fija sin tornillos de Rhein83</i>	Pág. 7
Prótesis fija sin tornillos Easy Fix	<i>Easy Fix: protocolo analógico y digital</i>	Pág. 8-9
	<i>Easy Fix: carga inmediata</i>	Pág. 10-11
Prótesis fijas Ot Bridge	<i>Pilares de titanio</i>	Pág. 12-13
	<i>Pilares calcinables</i>	Pág. 14
	<i>Tapones de cierre, transfer para impresión y análogos Ot Equator</i>	Pág. 15
	<i>Prótesis temporal con hilo armado</i>	Pág. 16
	<i>T-Bar Barra telescopica para carga inmediata</i>	Pág. 17
Aditamentos para implantología	<i>Ot Equator y Smartbox</i>	Pág. 18-19
	<i>Sphero Block y Sphero Flex</i>	Pág. 20-21-22
	<i>Medidor del borde gengival, Mini paralelometro</i>	Pág. 23
	<i>Broken screw extractor kit - Extractor de tornillos rotos</i>	Pág. 24-25
Barras CAD/CAM	<i>CAD/CAM Line - Conexiones roscadas intercambiables</i>	Pág. 26-27
	<i>Seeger system - Unión a barra pasiva</i>	Pág. 28-29
	<i>Ot Bar Multiuso - Barra calcinable</i>	Pág. 30-31
Sobredentadura	<i>Ot Equator calcinable</i>	Pág. 32-33
	<i>Esferas individuales Ot Cap</i>	Pág. 34-35
	<i>Contenedores calcinables Ot Box</i>	Pág. 36-37
	<i>Pivotes directos para sobredentaduras</i>	Pág. 38-39
	<i>Ot Lever - Palanca universal</i>	Pág. 40
	<i>Implantes desconocidos</i>	Pág. 41
Extracoronral	<i>Ot Cap y Ot Cap Tecno - Aditamentos calcinables extracoronales</i>	Pág. 42-43
	<i>Ot Strategy - Aditamento calcinable micro</i>	Pág. 44-45
	<i>Ot Strategy + Optional Steady - Aditamento calcinable micro</i>	Pág. 46-47
	<i>Ot Unilateral - Aditamento retención combinada para prótesis unilaterales</i>	Pág. 48-49
	<i>Ot Vertical - Aditamento extracoronario calcinable</i>	Pág. 50-51
Cierre	<i>Pin de cerradura Ot Lock - En titanio calcinable</i>	Pág. 52
Kit reconstrucción de esferas	<i>Esferas reconstructivas</i>	Pág. 53-54

Prótesis de sobredentadura directa


Contenedor de cofías de acero inoxidable





Cofía retentiva



Pilar Ot Equator



Contenedor para cofías autoparalizante Smart Box

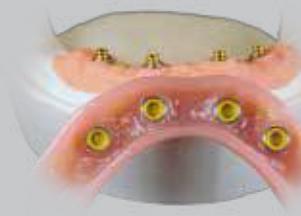

Prótesis removibles con doble estructura con barra primaria y secundaria

Cilindro contenedor calcinable



Pilar Ot Equator



Tornillo de bloqueo titanio



Anillo Seeger autoextraíble



Atache Ot Equator para vaina



Atache Ot Equator para barras rosadas



Vaina filetada de pegar



Prótesis fija sin tornillos Easy Fix


T-base extragrade para prótesis fijas sin tornillos



Seeger para prótesis fijas sin tornillos



Pilar Ot Equator

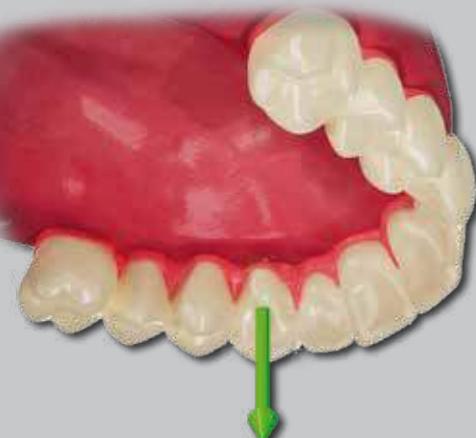

Prótesis fija atornillada tipo toronto bridge

T-base extragrade para prótesis fijas




Tornillo in titanio para t-base extragrade



Seeger blanco con mango para prótesis fijas



Pilar Ot Equator

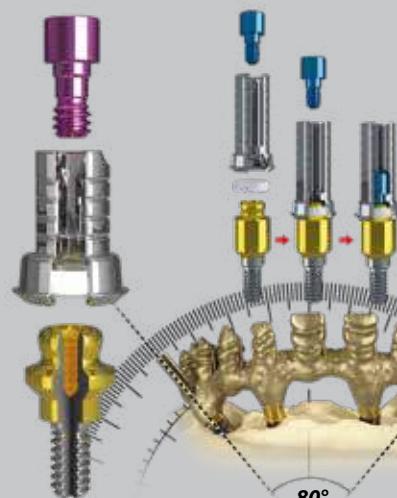

80°

**OT EQUATOR
EASY
Fix**

prótesis fija
sin tornillos



La ductilidad y multifuncionalidad del aditamento Ot Equator permite a los usuarios disponer de un único pilar para todo tipo de prótesis sobre implantes.

Algunas ventajas de utilizar el pilar Ot Equator

El personal quirúrgico se verá enormemente facilitado al manejar un único componente durante todas las fases quirúrgicas y protésicas, reduciendo significativamente el tiempo y la manipulación de componentes y accesorios. La verdadera revolución que ofrece el sistema, como el ahorro de materiales, instrumentos y tiempo de trabajo, es un aspecto fundamental para la clínica y el laboratorio, que también podrán utilizar el aditamento Ot Equator con las más modernas técnicas digitales compatibles con los más importantes software cad-cam. El aditamento Ot Equator se produce para todos los fabricantes de implantes conocidos y desconocidos en el mundo; por lo tanto, permite unificar todas las plataformas protésicas, permitiendo al cirujano utilizar incluso diferentes tipos de implantes en el mismo caso clínico.

- Ausencia de tornillos protésicos en los proyectos Full Arch
- Sellado protésico comparable a un sistema T-Base estándar
- Remoción atraumática gracias a un dispositivo de desbloqueo
- Inserción sencilla y segura hasta 60°
- Higiene periódica simplificada

OT EQUATOR EASY FIX

Easy Fix es la solución patentada de Rhein83 diseñada para crear estructuras protésicas fijas de arco completo sin el uso de tornillos. Gracias a una llave de liberación especial, las restauraciones pueden retirarse e inspeccionarse de forma sencilla y no invasiva. La innovadora T-Base incorpora un nuevo anillo Seeger de PEEK, que permite corregir angulaciones de hasta 60°. El sistema requiere solo un único orificio de acceso para el desbloqueo, el cual puede colocarse estratégicamente en la zona más conveniente y estética del diseño protésico, preservando así tanto la funcionalidad como la apariencia de la restauración. La retención de la prótesis fija se gestiona mediante tres niveles diferentes de retención del anillo Seeger, que pueden adaptarse según el número de implantes presentes. Easy Fix combina control, seguridad y flexibilidad de diseño en una única solución, permitiendo a los profesionales trabajar con cualquier plataforma y diámetro de implante, utilizando los pilares OT Equator.

1 Destornillador sólo para atornillar todos los componentes en el estudio y el laboratorio

1 Sólo transfer para toma de impresión

1 Único análogo de laboratorio compatible para todas las casas de implantes


PRÓTESIS FIJA EASY FIX

Prótesis fija sin tornillos



Retirada de prótesis simple

Para desbloquear la prótesis Easy Fix, hay que dejar un sólo agujero para insertar la herramienta de desbloqueo. Enroscando la herramienta de desbloqueo en el T-Base Easy Fix, la prótesis se levantará permitiendo una remoción atraumática de la prótesis.

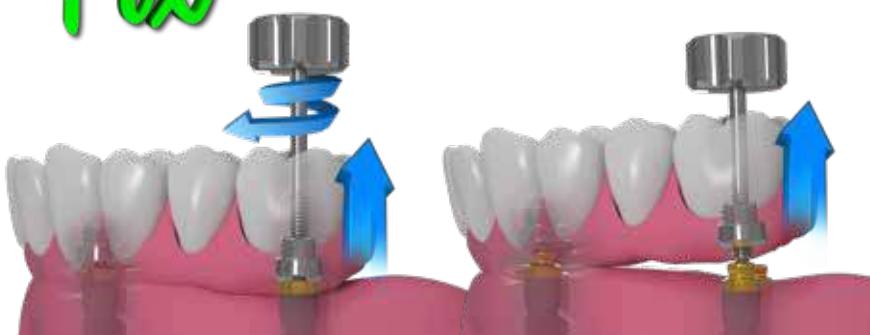

Retención Seeger "Fuerte"


Retención Seeger "Medio"

Retención Seeger "Suave"

Seeger para laboratorio

Tú eliges dónde colocar el agujero de desbloqueo

Con el sistema Easy Fix tiene la opción de dejar un sólo agujero de desbloqueo en el lugar más conveniente desde el punto de vista estético y funcional para su proyecto protésico.

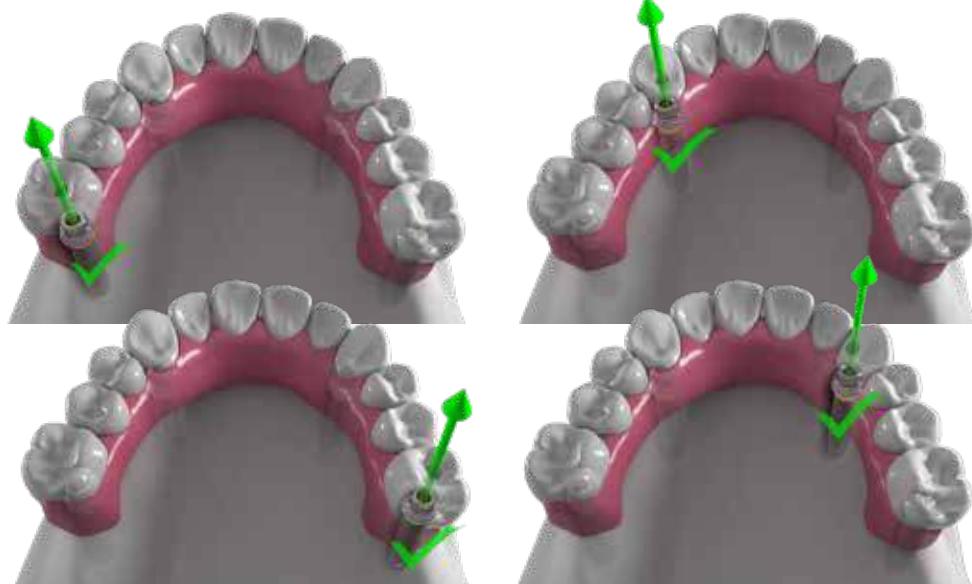

Pilar Ot Equator



Llave cuadrada



Llave cuadrada corta



T-Base



T-Base



T-Base



Seeger Blanco
SUJECCIÓN «FUERTE»




Seeger Rosa
SUJECCIÓN "MEDIUM"



Seeger Marfil
SUJECCIÓN "SOFT"



Seeger Negro
«LABORATORIO»



CON MANGO Y ESTUCHE



Vaina calcinable
H 4mm



Vaina calcinable
H 6mm



Vaina calcinable
H 9mm



Locking Screw
"OPCIONAL"



Tornillo espaciador



Tornillo de sellado



Llave dinamométrica



Transfer Ot Equator



Análogo ø4mm



Análogo digital
PER MODELLI STAMPATI



Scan abutment




PARA PEGAR METALES
(2 COMPONENTES)



Herramienta de desbloqueo
"LUNGO"



Instrumento insertador



Soporte T-Base

STUDIO**Construcción de la estructura Easy Fix: protocolo analógico**

Pilares Ot Equator colocados en la boca del paciente



Atornille los Transfers de Titanio en los pilares Ot Equator para proceder a la impresión.

Soporte para T-Base Easy Fix

El soporte para T-Base Easy Fix facilita la inserción de los anillos Seeger en su alojamiento correspondiente.

LABORATORIO**Construcción de la estructura Easy Fix: protocolo analógico**

Modelo de yeso con T-Base Easy Fix con tornillo de fijación y seeger de laboratorio.




Coloque las vainas calcinables sobre el T-Base Easy Fix



Diseñar una estructura



Cemento T-Base Easy Fix dentro de la estructura metálica con cemento Ot Cem

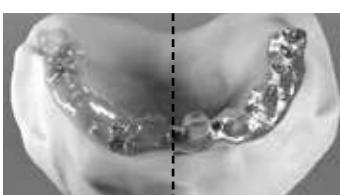

Armazón metálico con T-Base cementado



Obra terminada con agujero para herramienta de desbloqueo en posición16*



Mira el vídeo Easy Fix
protocolo analógico
En Youtube

CLÍNICA**Construcción de la estructura Easy Fix: protocolo digital**

Pilares Ot Equator colocados en la boca del paciente



Atornille el Scan Abutment en los pilares Ot Equator para proceder a la toma de impresión digital con un escáner intraoral.



Modelo impreso con análogos digitales en posición.



Fijar los análogos digitales con los tornillos a la base del modelo impreso.

LABORATORIO**Construcción de la estructura Easy Fix: protocolo digital**


Modelo de trabajo en yeso con réplicas de laboratorio.



Modelización de estructuras con bibliotecas digitales Rhein83



Cementar T-Base Easy Fix dentro de la estructura fresada con cemento Ot Cem

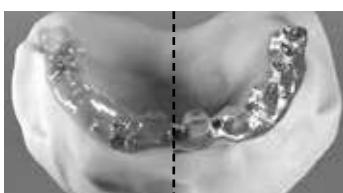

Estructura fresada con T-Base cementados en su lugar



T-Base Easy Fix en su lugar dentro de la estructura acabada



Obra terminada con agujero para herramienta de desbloqueo en posición16*




Mira el vídeo Easy Fix
protocolo digital
En Youtube

PRÓTESIS FIJA EASY FIX

Prótesis fija sin tornillos

**EASY
Fix**

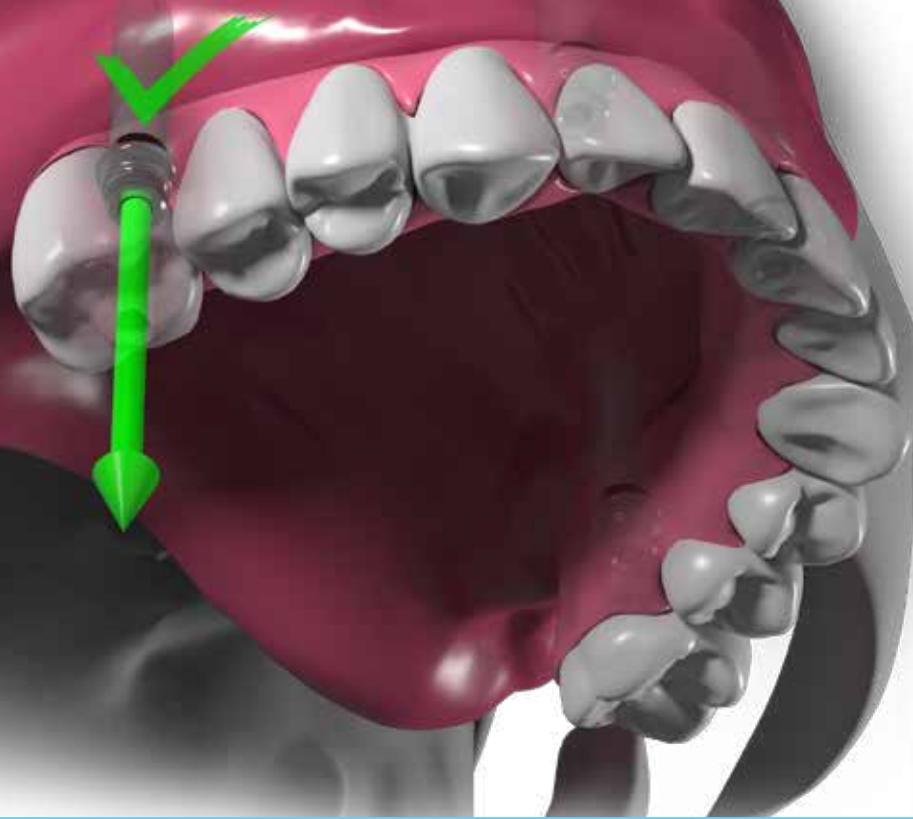

Prótesis fija sin tornillos

La sujeción de la prótesis está garantizada únicamente por los especiales Seeger Easy Fix.



Locking screw optional

Se recomienda utilizar el tornillo opcional «Locking screw» para llenar el orificio de desbloqueo.



CLÍNICA

Carga inmediata



El sistema de prótesis fijas sin tornillos Easy Fix se puede utilizar en todo tipo de cirugía de implantes.



Después de colocar los implantes, atornille los pilares Ot Equator de la altura deseada.



Utilizando el vástago insertador especial, coloque el seeger del color elegido dentro de las T-bases en de titanio.




Colocar las t-base en la posición correcta.



Con la herramienta de inserción, coloque las T-base en los attaches Ot Equator.



Coloque las T-base con la parte extragrade en verde, en correspondencia con la máxima divergencia de los implantes.

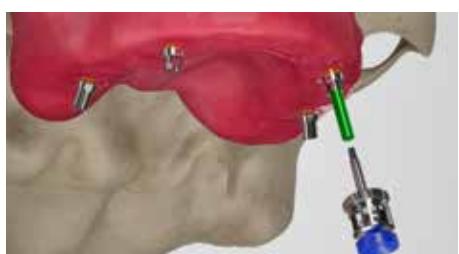

Atornille el tornillo largo de trabajo en la T-base donde se ha decidido dejar abierto el orificio de desbloqueo de la prótesis.



Cerrar con material inerte las T-base restantes.



Aplicar el cemento metal-metal Ot Cem sobre las t-base.



Fijar las t-base en la estructura.



Retirar el tornillo largo.



Inserte la llave de desbloqueo que desplazará la prótesis de forma rápida y atraumática.



El uso del tornillo "Locking screw" es opcional, pero se recomienda para llenar el orificio de desbloqueo.



Mira el video Easy Fix
carga inmediata
En Youtube

PRÓTESIS FIJAS OT BRIDGE

t-base en titanio + vaina calcinable para pegar

T-base en titanio con agujero pasante y vaina calcinable

Los t-base en titanio con tornillo pasante se utilizan en todas las prótesis donde el disparalismo no crea problemas estéticos de bóveda en el arco dental. Los t-base en titanio extragrade están disponibles en tamaño estándar y mini.

T-base extragrade ESTÁNDAR




T-base en titanio inclinados 15° con agujero y vaina calcinable

Los t-base Extragrade en titanio se utilizan para construir las prótesis fijas "Seeger Bridge" incluso sobre implantes muy disparaleos, aprovechando la subcuerda como una unión retentiva con solo el Seeger para obtener una retención "snap".

T-base extragrade INCLINADO 15°



T-base extragrade MINI

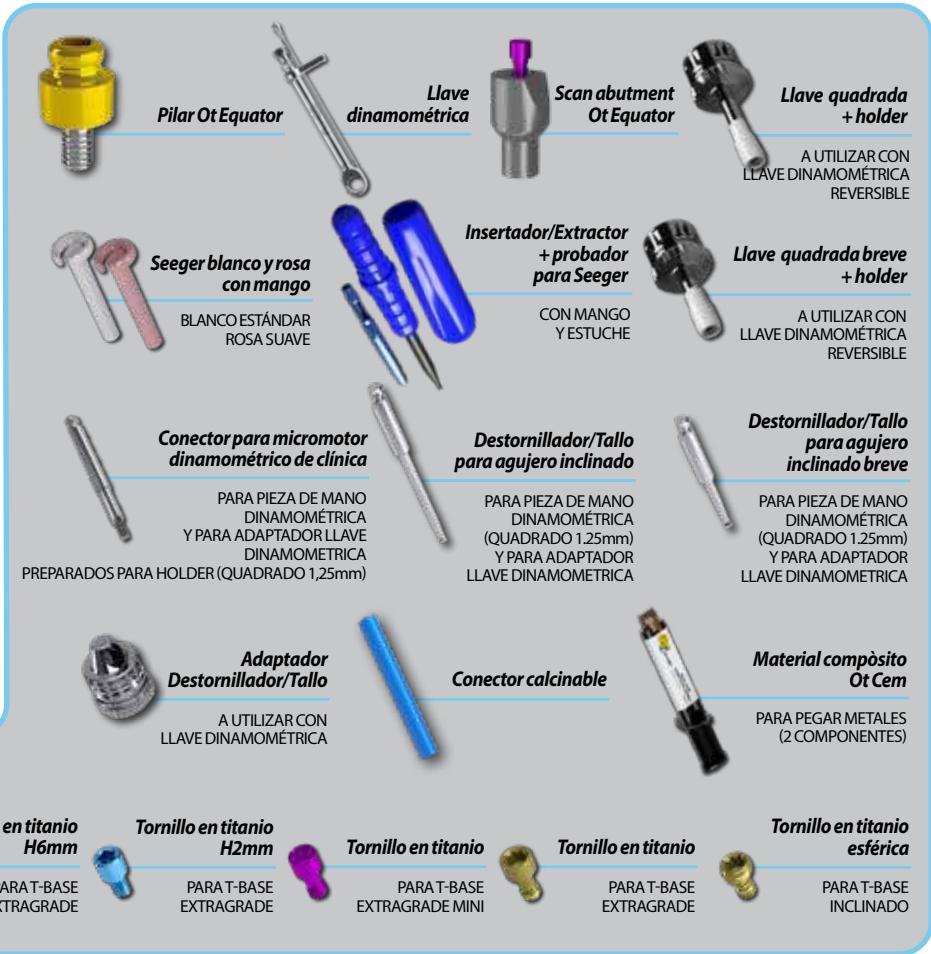

LABORATORIO *t-base en titanio con y sin tonillo + vaina calcinable*


Análisis del modelo utilizando el paralelómetro Rhein83



Análisis de la divergencia entre implantes.



Análisis de la dimensión del montaje. Proyecto que implica el uso de t-base de titanio con tornillo, vainas de enculado y t-base de titanio sin tornillos con una inclinación de 15°.



Tornillo largo atornillado sobre el análogo Ot Equator, para comprobar la dirección futura del agujero.



T-base en titanio Extragrande con agujero, inclinado 15°. El Seeger blanco debe insertarse con la abertura en la dirección de la socavación.




En caso de excesiva inclinación del implante, se puede utilizar un t-base en titanio con vaina de enculado, con una inclinación de 15° sin agujero y tornillo de anclaje. El muñón será retenido únicamente por el Seeger blanco. El porcentaje de t-base sin tornillo de fijación debe limitarse al 25% (en este caso 1de 4).



Es importante colocar el t-base en titanio con la pared plana en el lado divergente, ya que corresponde al biselado llamado Extragrade, que permitirá a la viga superar socavaciones entre los implantes.



El Seeger tiene que tener la parte abierta del lado divergente, posición que es forzada por un paso antirrotatorio que se encuentra dentro del filete.

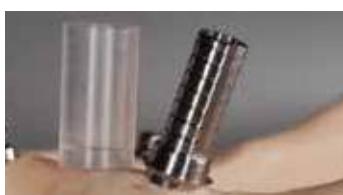

La vaina calcinable permite la construcción de una estructura que se colará. Después se pegarán pasivamente los t-base extra grade en titanio.



La estructura calcinable debe ser lo más pasiva posible. La pasividad se facilita mediante el uso de conectores gingivales calcinables que pueden adaptarse, cortarse y moldearse, tratando de dejar el menor espacio posible entre estos y el t-base del implante.



Estructura calcinable lista para colar.



Antes de la cementación, insertar el marco. Es importante cementar los elementos uno por uno. Se recomienda el uso del cemento compuesto Ot Cem de Rhein83.



Coloque el t-base de titanio extragrade sobre el t-base Ot Equator asegurándose de que la pared fresada quede orientada hacia la socavadura.



Espolvoree con cemento tanto la parte exterior del t-base de titanio como la superficie interior del conducto a unir. Tenga cuidado de rociar el tornillo con vaselina.



Asegúrese de que la pared fresada del t-base extragrade permanece en la posición correcta.



Trabajo pulido, montado, listo para ser recubierto con el material estético.

CLÍNICA
LABORATORIO *soluciones digitales para la línea Ot Bridge*


Escanee los Scan Body en la boca. La pared fresada del Scan Body debe estar orientada hacia la socavadura del implante.



Escanado del Scan Body para el diseño Cad. La pared fresada del Scan Body corresponde a la parte extragrade del t-base de titanio y debe estar orientada hacia la socavadura del implante.

SOLUCIÓN A

Escanado directo del t-base de titanio para el diseño Cad.

SOLUCIÓN B


PRÓTESIS FIJAS OT BRIDGE

T-base calcinables

T-base calcinable con tornillo pasante y seeger



T-base calcinable sin tornillo, sólo seeger

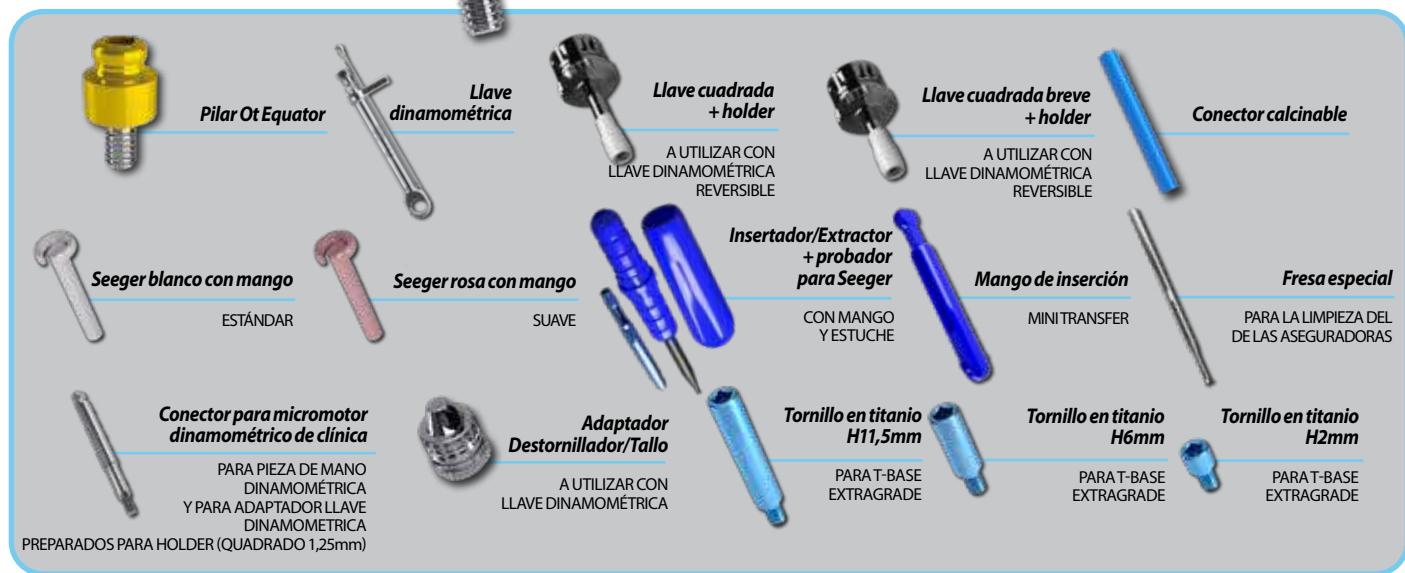

LABORATORIO

T-base calcinables



Cuando el espacio es limitado, puede utilizarse el t-base calcinable Extragrade. Este también permite superar pasivamente divergencias considerables y, una vez colado, puede moldearse para limitar el espacio.



En el t-base calcinable con tornillo, así como para el t-base de titanio con tornillo, se puede ver el bisel llamado Extragrade.



La posición del Extragrade se indica mediante una pared plana que siempre debe colocarse en la parte inclinada del elemento.



Barra moldeada con pernos de fundición lista para el revestimiento.



Detalle del t-base calcinable después de colado y arenado.



Cortador especial utilizado para limpiar el óxido o cualquier pequeña burbuja en el interior del núcleo fundido.




Compruebe la precisión del vaciado con el análogo de Ot Equator antes de proceder al acabado y pulido de la estructura.



Viga pulida y lista para ser acabada con revestimiento estético.



Insertar el Seeger como se pude ver en la foto colocando la sección abierta en el lado inclinado del t-base.

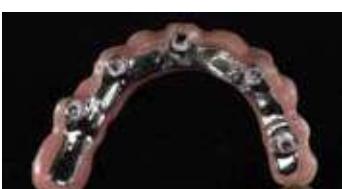

Trabajo terminado visto desde abajo (caudal).



Vista vestibular. Se puede ver que gracias a los t-base pre-angulados y al Seeger no hay agujeros vestibulares.



Trabajo terminado.

CLÍNICA

Tapones de cierre



Opción 1: Tapón de cierre atornillado sobre el pilar OT Equator.



Opción 2: OT Equator Seeger Tapón atornillado sobre el pilar OT Equator.



Ejemplo de las dos opciones atornilladas sobre el pilar OT Equator.

CLÍNICA

Transfer para impresión



Solución con el uso de transfer en metal más el tornillo.



Transfer a tiron de cuerpo largo



Transfer a tiron bajo ideal en situaciones donde hay poco espacio vertical.

LABORATORIO

Réplicas de acero Ot Equator



Si las réplicas arrancables permanecen en la boca, sepárelas y conéctelas al análogo de laboratorio y vuelva a colocarlas en la impresión.



Con la ayuda del transfer de laboratorio, vuelva a colocar correctamente las transferencias de plástico en la impresión.



Impresión preparada para ser moldeada en yeso.

LABORATORIO

Réplicas de acero OT Equator con tornillo de titanio para Cad/Cam



Modelo moldeado con carcasa triangular para Cad/Cam analógico de acero inoxidable.



El análogo se detiene con un tornillo introducido desde abajo.




Modelo terminado.

PRÓTESIS FIJAS OT BRIDGE

Prótesis temporal con hilo armado



Solución ideal para casos con carga inmediata o para todos los casos en los que se requiere un provisional para proporcionar una excelente solidez estructural

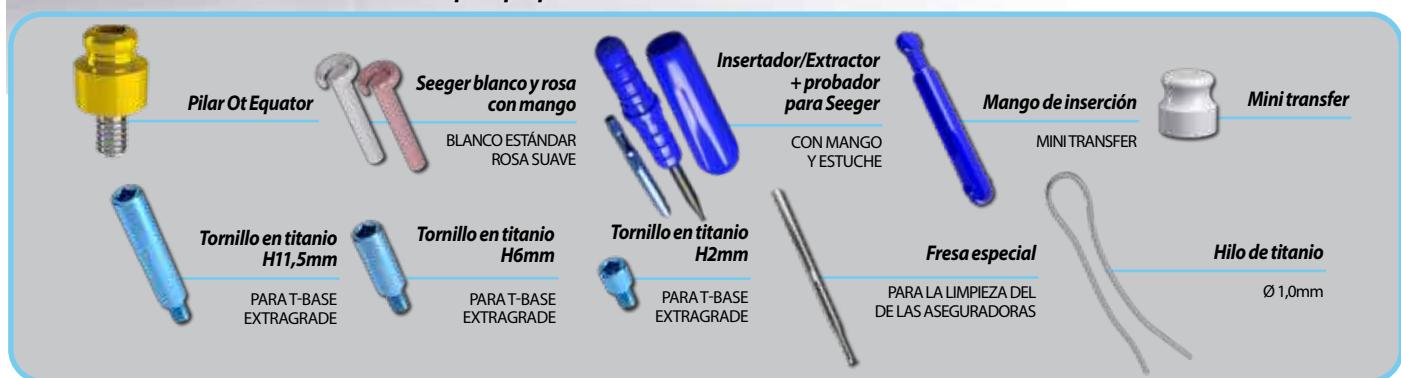

LABORATORIO


Prótesis temporal con hilo armado



Hilo en titanio para la construcción de estructuras con hilo armado.



Hilo en titanio insertado en un agujero muñón pasante de 1mm de diámetro.

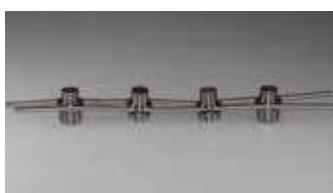

Insertar el hilo en titanio en los agujeros de los muñones en titanio.



Atornillar los t-base en titanio con agujero pasante de uno en uno y adaptar el hilo en titanio siguiendo el perfil adecuado.



Dientes posicionados y reducidos de acuerdo con la máscara y los espacios disponibles.



Los t-base en titanio para hilo armado pueden adaptarse en relación con las dimensiones generales, todo se opacificará adecuadamente y luego se ensamblará con resina auto-endurecible.



Los t-base para hilo armado no tienen el bisel Extragrade, por lo que en caso de que fuera necesario, tiene que crearse manualmente, prestando la mayor atención una vez terminado el trabajo, siempre en el lado divergente.



Es muy importante que los Seeger se positionen de modo que la abertura esté en la dirección del socavado del implante.



Inserción de los Seegers en todos los t-base en titanio.



Incluso con puentes temporales hay que seguir las líneas de inserción para insertarlos correctamente sobre el modelo y en boca al paciente.



En el caso de un fuerte disparalismo (como por ejemplo el all on four), es recomendable insertar primero el puente sobre los t-base más inclinados, que en este caso son los diafrámicos, y luego pasar a los frontales haciendo que encaje en la posición correcta.



El puente en resina hilo-armada se termina y se entrega al dentista en aproximadamente 2 horas.


Barra telescópica diseñada para la carga inmediata con la que se pueden crear estructuras atornilladas sin tensión sobre los implantes; disponible con insertos (opcionales) para la retención de dientes usando la técnica de unión sin fusiones y soldaduras.




También se puede utilizar para los puentes atornillados. Disponible en acero de grado médico y titanio grado 5. En la versión de titanio es posible soldar las uniones a las torretas de los implantes.




Junta

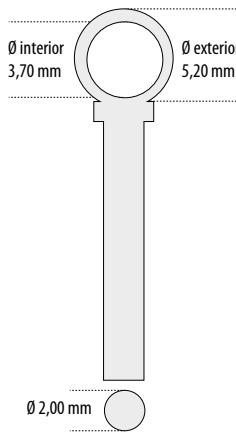

Cilindro con insertos de retención

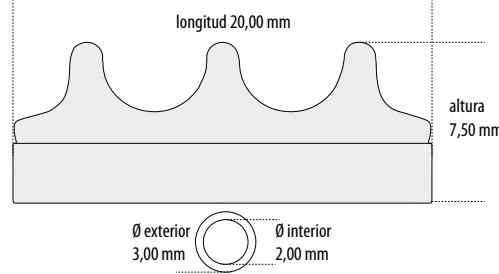

Cilindro

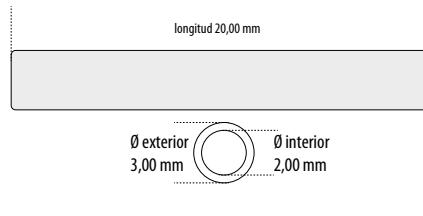

OT EQUATOR PARA IMPLANTES

Pilar en titanio a perfil reducido



Pilar Ot Equator

LA ALTURA DEL FILO CURATIVO ESTÁ DISPONIBLE EN 0,5 A 7mm



Transfer para impresión



Transfer para impresión



Réplica de acero



Llave a sección cuadrada 1,25 mm + Holder para OT Equator

COMPATIBLE CON CARRACA DINAMOMÉTRICA



Conector a sección cuadrada 1,25 mm para contrangulo de clínica

CUADRADO 1,25mm



Holder intercambiable

PARA OT EQUATOR



Distanciador para contenedor

OT EQUATOR



Discos de protección



Llave dinamométrica



Insertador/Extractor de cofias

NORMAL/MICRO - OT EQUATOR



Contenedor de cofias

ACERO INOXIDABLE



Contenedor de cofias

Titanio



Contenedor de cofias Smartbox

CON COFIA NEGRA DE POSICIONAMIENTO



Cofia negra Smartbox

DE POSICIONAMIENTO



Cofia morada

FUERTE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 2700g



Cofias blancas transparentes

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 1800g



Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 1200g



Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 600g



Cofias negras

SIN RETENCIÓN EXCLUSIVO PARA LABORATORIO



Cofias agua de diámetro interior reducido

FUERTE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 1300g



Cofias naranja de diámetro interior reducido

MUY ELÁSTICA - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 350g



El contenedor de cofias **autoparalelizable** de la línea Ot Equator



fulcro de rotación


contenedor en titanio anodizado

mecanismo basculante

cofia retentiva Ot Equator

Inserción atraumática

corrige disparalellismos hasta 50°

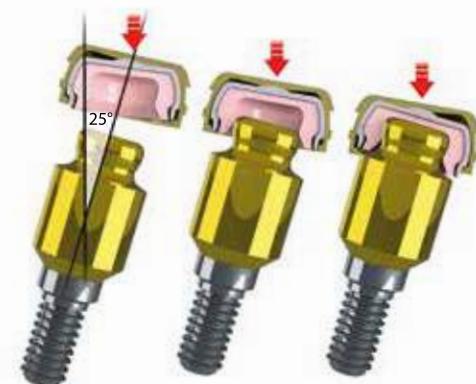

CLÍNICA**Fijación de las cofias directamente en la clínica**

Atornillar el pilar Ot Equator personalizado con la altura adecuada al perfil gingival.



Poner los discos de protección y insertar cofias y contenedor encima, en posición.



Controlar el correcto posicionamiento de la prótesis antes de fijar las cofias con sus contenedores.



Llenar los agujeros con resina auto polimizable y posicionar la prótesis en boca al paciente.



Remover la prótesis y controlar el correcto posicionamiento de las cofias y de los contenedores.



Remover los discos de protección.



Recortar el exceso de resina con cuidado.



Prótesis terminada

CLÍNICA**Impresión de trasferencia**

Posicionar el transfer para impresión sobre el Ot Equator



Insertar la réplica en posición y colar el modelo en yeso.



Poner pivotes en la estructura y quitarla. Asegurarse de que los contenedores de acero inoxidable no se quedan adentro, ahora proceder poniendo el revestimiento.



Estructura metálica con contenedores de acero inoxidable pegados en su lugar.

CLÍNICA**Fijación de la Smartbox en la boca del paciente**

Atornille el pilar OT Equator adecuado a la altura del margen gingival.



Posicionar el disco protector sobre la semiesfera OT Equator.



Coloque una gota de resina en el espacio preparado para alojar la Smartbox e introduzca la prótesis en la boca.



Una vez finalizada la polimerización, retire la dentadura con las Smartboxes incluidas, teniendo cuidado de retirar también los discos protectores.



Termine la prótesis conservando la tapa negra que protege la Smartbox.



Cuando la prótesis esté terminada, retire la tapa negra. El mecanismo Smartbox ya puede moverse libremente.



Inserte la cofia de retención deseada con la herramienta de inserción.



Trabajo terminado.



Vea el vídeo de Ot Equator en Youtube



Vea el vídeo de Ot Equator SmartBox en Youtube

SPHEROFLEX/SPHERO BLOCK


En Titánio + rivestimiento TiN (más de 1600 Vickers) para soluciones paralelas

Sphero FLEX

Sphero BLOCK




Los aditamentos SPHERO FLEX son los únicos aditamentos con la esfera móvil que se inclina en todos los sentidos de 7,5° teniendo en cuenta también la elasticidad de la cofia retentiva. La inserción de la prótesis es posible también en las situaciones de disparalelismo marcado, con traumas mínimos. Es difícil que los aditamentos SPHERO FLEX y SPHERO BLOCK se desatornillen espontáneamente si se respetan las instrucciones por el atornillamiento sobre implantes, o sea: Utilizar la llave adecuada para atornillar el aditamento sobre el implante. Apretar adecuadamente y después desatornillar volviendo a repetir esta operación más veces (4-5) para permitir un buen ajuste de las superficies filetadas. Los aditamentos SPHERO FLEX y SPHERO BLOCK se producen bajo pedido para todo tipo de implantes. En el pedido hay que especificar con precisión: La marca y el diámetro del implante. La altura del borde gingival B.D.G. disponible de 1 a 7 mm. Para las marcas más famosas, entregas diarias, para marcas menos famosas tardan 4-5 días.

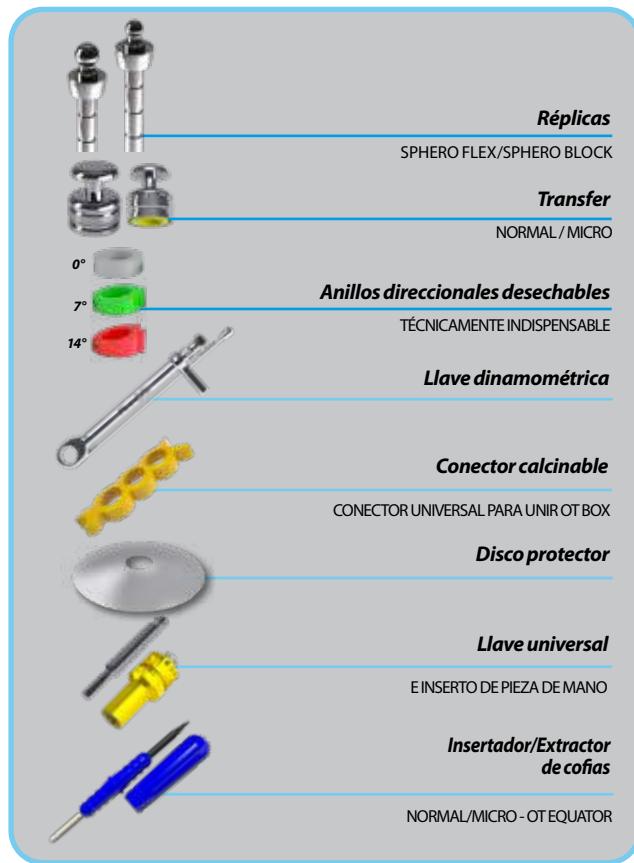

Contenedores de acero inoxidable para cofias	PARA RESINA Y SOLDADURA
Contenedores de cofias de titanio	PARA RESINA Y SOLDADURA - EL ANODIZADO FUCCSIA MEJORA EL CAMUFLAJE EN PRÓTESIS DE RESINA
Distanciadores para contenedores	NORMAL/MICRO
Cofias blancas	ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1300g / MICRO 1100g
Cofias rosas	SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 900g / MICRO 800g
Cofias amarillas	EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g
Cofias verdes	ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g
Cofias super resilentes oro	LIGERAMENTE ELÁSTICO - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g
Cofias super resilentes plata	ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g
Cofias negras	No retención - laboratorio
Cofias titan cap	SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1500g / MICRO 1300g
Cofias a diámetro interior reducido agua	ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1300g / MICRO 1100g
Cofias a diámetro interior reducido rosa	SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 900g
Cofias a diámetro interior reducido amarillas	EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g
Cofias a diámetro interior reducido naranja	ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g

LABORATORIO

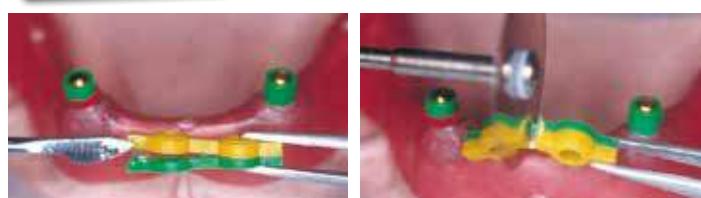

Anillos direccionales (color verde) colocados en la base del aditamento. El posicionador plástico OT BOX se coloca sobre ellos, Barras OT BOX ya pegadas. Cortar el exceso de barra OT BOX y utilizar solo la parte que se convertirá en el contenedor para la cofia retentiva. El OT BOX debe colocarse sobre el posicionador plástico.

CLÍNICA**Correcto posicionamiento de los anillos direccionales**

Posicionamiento incorrecto



Posicionamiento correcto

Antes de posicionar el transfer para impresión sobre el implante se recomienda utilizar un anillo direccional gris (para implantes paralelos) o, en alternativa, un anillo angulado para implantes no paralelos. Eso mantendrá el transfer de impresión a la altura adecuada. Los anillos direccionales.

CLÍNICA**Fijación de cofias en la boca del paciente con anillos direccionales**

Atornillar los aditamentos a la altura apropiada de la encía. Apretar el tornillo todo lo necesario. Desatornillar y atornillar de nuevo, efectuar esta operación 3-4 veces para obtener un buen ajuste.

Insertar los ANILLOS DIRECCIONALES bajo las esferas.

Es aconsejable quitar la cofia retentiva, insertar el disco protector sobre las esferas y colocar de nuevo la cofia retentiva.

Probar la prótesis en la boca y comprobar si los espacios son lo suficientemente grandes



Cuando la resina se haya endurecido, retire la prótesis y los discos protectores, y recorte el exceso de resina.



Guarda il video Sphero Flex e Sphero Block su Youtube

CLÍNICA**Toma de impresión de transferencia**

Colocar los anillos direccional con la angulación correcta y insertar los transfert sobre las esferas.

Girar los anillos direccionales para lograr un eje paralelo común con el plano oclusal y tomar una impresión.

Impresión detectada, retirar los anillos de dirección si estaban todavía en la esfera o en la impresión.

Introducir las replicas en los transfert y vaciar el modelo. Así se tendrá la transferencia y la orientación de la posición de los pilares.

LABORATORIO**Ot Box Classic NORMAL - prótesis de resina con refuerzos colados y anillos direccionales**

Fase de modelado: El contenedor OT BOX en posición y conectado a las otras piezas con resina autocurable.

Refuerzo modelado, acabado también con cera y pins para evitar la rotura de los dientes.

Refuerzo colado sobre el modelo, con pins metálicos para cada diente.

Prótesis acabada con cofia insertada en los contenedores colados.

LABORATORIO**Construcción de prótesis sólo de resina con anillos direccionales**

Atornillar el aditamento al modelo, eligiendo la altura apropiada de la vuelta.

Montar los anillos direccionales y girarlos hasta que se encuentre el paralelismo óptimo.

Como las cofias de retención son elásticas, trabajan muy bien si se incorporan al acrílico y en las carcasa prefabricadas de acero inox.

Prótesis acabada con cofias de retención y carcasa de acero inox.


SPHERO FLEX/SPHERO BLOCK

En Titánio + rivestimiento TiN (más de 1600 Vickers) para soluciones paralelas

CLÍNICA

Sphero flex - Sphero block

TECNICAMENTE INDISPENSABILI ANELLI DIREZIONALI MONOUSO

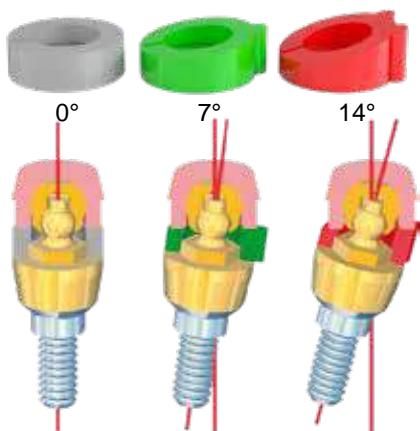

Para fijar las cofias retentivas sobre los ataches a esfera "SPHERO FLEX y SPHERO BLOCK" es fundamental utilizar los "Anillos Direccionales" para establecer de la manera más segura una línea paralela al plano de la prótesis removible. En el caso de que no se utilicen estos "Anillos Direccionales" se puede correr el riesgo de una fijación incorrecta de las cofias nada menos que contraria al eje de inserción. Esto puede agravar problemas que ya existen a nivel de falta de paralelismo, aumentando el riesgo de traumas en el uso de la prótesis. Elegir el "Anillo Direccional" como soporte para las cofias según la dirección de los implantes. En el caso de que sean

Sphero FLEX



Sphero BLOCK



paralelos, utilizar el anillo 0° como soporte de apoyo, en otros casos corregir según el disparalelismo aplicando el anillo a 7° o 14°. Insertar el anillo direccional desde el lado justo sobre el hexágono del atache (el hexágono tiene que entrar en el alojamiento adecuado interno al anillo). Luego poner la cofia retentiva sobre la esfera y girar el "Anillo Direccional" hasta que se obtenga la posición de la cofia paralela según la dirección de las cofias ya insertadas y orientadas sobre otros implantes. Solamente así se tendrá la certeza de que las cofias retentivas sean alineadas y fijadas correctamente dentro de la prótesis removible.

CLÍNICA

Llave universal - instrucciones de uso



La llave universal para Sphero Block-Flex cuenta con un mecanismo de deslizamiento (color oro) que cuando se abre y se cierra bloquea el complejo esfera-hexágono del abutment. El mecanismo de la llave debe estar completamente apretado sobre el hexágono del abutment para atornillarlo correctamente sin dañarlo. (Es aconsejable apretar y aflojar el pilar varias veces antes de apretarlo definitivamente con el fin de garantizar una mejor microadesión entre los filetes machohembra de pilares e implantes). Si se utiliza la llave dinamométrica o electrónica, se aconseja un valor de 25Nm. Una vez apretado el abutment, empujar hacia abajo la cabeza de color plata de la llave para desconectarla.

CLÍNICA

Medidor de esferas



Rhein83 siempre atenta a las necesidades de odontólogos y protésicos, ha realizado una herramienta muy sencilla pero fundamental en algunos casos específicos. El medidor de esferas permite comprobar el diámetro de los aditamentos esféricos de forma muy sencilla y segura gracias a sus cuatro orificios que corresponden a los tamaños más comunes:

1.6-1.8 2.25-2.5mm.



CLÍNICA

Cuña elástica

SISTEMA "ANTI DESTORNILLAMIENTO" UNIVERSAL CON CUÑA ELÁSTICA



Construido con material inerte y biocompatible. Se adapta en la fase de atornillamiento. Cuando el dispositivo está apretado en la posición final, la cuña vuelve a su forma original (memoria elástica) disminuyendo la posibilidad de movimiento creado por los esfuerzos. La cuña se aplica SOLO BAJO PEDIDO a todos los tornillos de diámetro superior a 1,8 mm.

CLÍNICA

Medidor de borde gingival

**Misuratore
BG**



Medidor necesario para tomar visualmente la profundidad gengival de los implantes (hexagonal interno o externo), para pedir un pilar Rhein83 con altura exacta del borde de curación.

MEDIDOR UNIVERSAL MILIMÉTRICO A COLORES CON RODILLA PARA IMPLANTES

Mantener el plato giratorio atornillado por encima, lejos de pivote con la base de apoyo del perímetro sobre el eimplante. Insertar el tallo del medidor en el implante hasta apoyar el perímetro de la base. El plato giratorio estará lejos de la encía. Sostener el medidor en su lugar con los dedos y girar la placa de las agujas del reloj, que se reducirá en la encía. Cuando la base del plato giratorio rozará la encía, delimitará la altura del borde gingival. Retirar el medidor de la boca, leer el color. El área de color donde el medidor se detiene, indica la altura del pilar que se referirá redondeando al milímetro. Cuando un color se cubre totalmente o casi, para pedir el pilar de la medición justa, es aconsejable referirse al color superior. EJEMPLO : para pedir un pilar hay que especificar la marca, el diámetro del implante y el color de la altura indicada. Este código de color corresponde a un milímetro que, partiendo de la base del implante, mide la altura de los bordes de curación de los pilares. Estos van de 0,5 mm a 7 mm de hexágono interno. Para los implantes con hexágono externo, la altura varía de 1mm a 6mm dependiendo del tamaño del hexágono sobre el implante.



Ver el vídeo Medidor de borde gingival en Youtube

KIT EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

La solución para extraer tornillos rotos de implantes

Un tornillo roto dentro de un implante es un problema grave aunque poco frecuente. Con el sistema BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT, un tornillo roto puede extraerse del implante si no se ha cementado o si las rosas del interior del implante no se han dañado en un intento de extracción anterior. En el 90% de los casos, el tornillo roto puede desatornillarse fácilmente, pero la operación debe realizarse con gran habilidad, paciencia y atención. El tiempo necesario para la extracción puede depender de muchos factores, incluida la posición del implante, que puede facilitar o complicar la operación.

PRECAUCIÓN:

Durante el uso, es obligatorio enfriar el CUERPO CENTRÍFUGO, la BROCA ARTILLAR y la BROCA ESPECIAL con abundante agua para no sobrecalentar el implante; esto protegerá al hueso de cualquier riesgo de sobrecalentamiento y necrosis. La eficacia del ARTILLAR Y LA BROCA ESPECIAL es óptima para tres extracciones de un tornillo roto.

El ARTILLO ESPECIAL es extremadamente duro pero quebradizo a la flexión; para evitar que se rompa, es absolutamente necesario que el CUERPO CENTRAL no se mueva durante toda la operación.



Radiografía del fragmento de tornillo roto

Para algunos tipos de conexión el KIT EXTRACTOR TORNILLO ROTURA está disponible en stock; para otros tipos de conexión es necesario iniciar la producción y los plazos de fabricación aumentan hasta un máximo de 10 días laborables.



DISPONIBLE PARA

- Implantes con HEXÁGONO INTERNO (tipo SCREW VENT y similares)
- Implantes con HEXÁGONO EXTERNO (como BRANEMARK y similares)



FRESA DE AGARRE (C) insertada en el CONTENEDOR DE FRESA MANUAL (B) para la extracción manual del tornillo roto



Tornillo roto que se retira




Fresa especial (D)



Fresa de agarre (C)



Fresa de agarre (C)

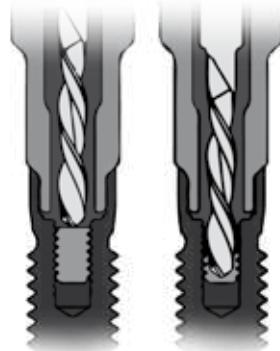

Fresa especial (D)

Contenedor de fresa manual (B)

Centrador (A)

COMPONENTES Y ACCESSORIOS

- A CENTRADOR
- B CONTENEDOR DE FRESA MANUAL
- C FRESA DE AGARRE
- D FRESA ESPECIAL

KIT EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

La solución para extraer tornillos rotos de implantes

CLÍNICA

Kit extractor de tornillos rotos - fresa de agarre con contenedor de fresa manual



Tornillo roto en el implante



Insertar la fresa de agarre en el centrador con el contenedor de fresa manual



Introdúcalos en el implante y, ejerciendo una presión constante sobre el tornillo roto con el contenedor de fresa manual, desenróquelo y retírelo del implante girando en sentido antihorario.

CLÍNICA

Kit extractor de tornillos rotos - fresa de agarre con contra-ángulo



Utilice la fresa de agarre junto con el contra-ángulo en caso de que el tornillo se atasque dentro del implante.



Inserte la fresa de agarre en el contra-ángulo de implante 20:1. Ajuste el programa de inserción del implante en sentido antihorario e insista en el tornillo roto para aplanarlo.



Utiliza una velocidad entre 10 y 30 rpm, y prepárala para la fresa especial que la destrozará.

CLÍNICA

Kit extractor de tornillos rotos - fresa especial con contra-ángulo



Introduzca la fresa especial en el contra-ángulo de implante-ología 20:1. Ajuste el programa en sentido antihorario con una velocidad entre 500 y 600 rpm.



Enfrie con abundante agua durante esta operación. Introduzca la fresa especial en el centrador, inicie la rotación, manténgala durante no más de 3 segundos en el tornillo roto y suéltela. Este movimiento alternado facilita la entrada de agua para enfriar el sistema y la fresa.



Es absolutamente necesario que el centrador no se mueva durante toda la operación. Si el centrador se movea, la fresa especial se romperá. Una vez que todas las incisiones láser de la fresa especial desaparecen en el centrador, la operación ha finalizado y el tornillo está completamente destruido. Una vez destruido el tornillo, se puede eliminar cualquier viruta de la cavidad con aire, agua y succión.

EL KIT EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS PODRÍA TENER PROBLEMAS DE ESPACIO EN LA PARTE POSTERIOR, QUE PODRÍAN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO. ES IMPORTANTE ANALIZAR LA SITUACIÓN ANTES DEL USO DEL KIT.



Ver el vídeo
Broken Screw en Youtube

CAD/CAM LINE - ATACHES ROSCA DOS INTERCAMBIABLES

Ataches para barras ya roscadas con paso estándar de 2 mm



NORMAL/MICRO

**ESFERA NORMAL
ESAGONO 1.3 mm**



rosca 2 mm
estándar

**ESFERA MICRO
ESAGONO 0.9 mm**



rosca 2 mm
estándar



OTEQUATOR
CUADRADO



rosca 2 mm
estándar



Espaciadores para vaina Ot Cap

NORMAL/MICRO



Llaves hexagonales

EXAGON 1.27mm EXAGON 0.9mm



Contenedores de acero inoxidable para cofias

PARA RESINA Y SOLDADURA



Contenedores de cofias de titanio

PARA RESINA Y SOLDADURA - EL ANODIZADO FUSCIA
MEJORA EL CAMUFLAJE EN PRÓTESIS DE RESINA



Cofias blancas

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 1300g / MICRO 1100g



Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 900g / MICRO 800g



Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g



Cofias verdes

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g



Cofias negras

No retención - laboratorio

Espaciador para vaina

OT EQUATOR



Llave Ot Equator

+ HOLDER INTERCAMBIABLE



Contenedor de cofias

ACERO INOXIDABLE



Contenedor de cofias

Titanio



Cofia morada

FUERTE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
2700g



Cofias blancas transparentes

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
1800g



Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
1200g



Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
600g



Cofias negras

SIN RETENCIÓN
EXCLUSIVO PARA LABORATORIO



Insertadora/extractora de cofias

NORMAL/MICRO - OTEQUATOR




Llave para paralelometro



Material compuesto Ot Cem

PARA PEGAR METALES
(2 Componentes)

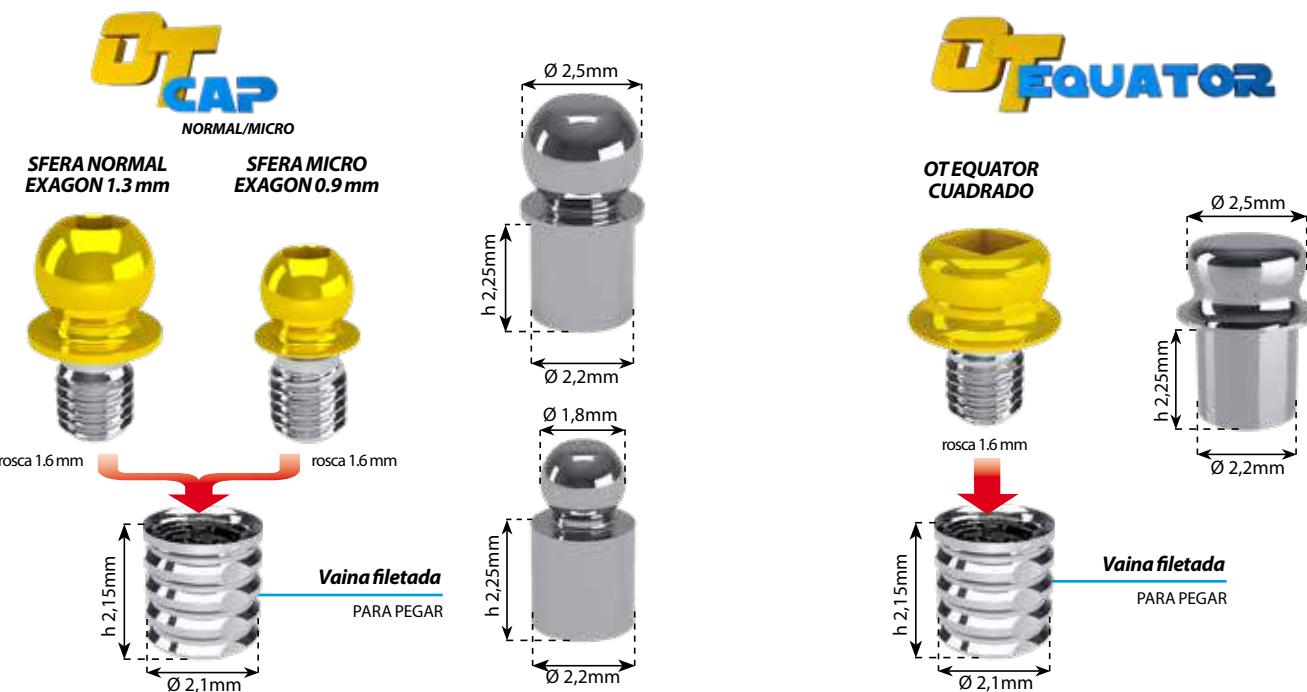

LABORATORIO Montaje attaches con vaina roscada de pegar



Cuando la barra está construida, con el espaciador de acero crear el agujero donde el atache roscado deberá ser posicionado en la vaina.



Elegir el espaciador del atache (normalmicro; ot equator) después de tenerlo aislado, posicionarlo con la llave adecuada del paralelometro.



Completar el modelado con los ESPACIADORES DE VAINA en posición.



Remover los ESPACIADORES EN VAINA y proceder a la fundición de la barra.



Atornillar el atache en la vaina roscada.



Posicionar el atache ensamblado con la VAINA ROSCADA en la llave de paralelometro y aplicar compuesto resina anaeróbico metal - metal alrededor de la vaina y en el agujero.



Esperar el endurecimiento del compuesto, acabar el trabajo.



Una vez endurecido el compuesto, se puede destornillar el atache para controlar la perfecta adhesión del material compuesto.



Barra terminada con attaches en posición. La intercambiosidad del atache es garantizada por la vaina pegada unida en la barra.



La técnica es la misma para todos los attaches



Ver el video
esferas roscadas en Youtube

BARRAS CAD-CAM SISTEMA SEEGER

Unión a barra pasiva



El anillo seeger está construido en peek, su función es compensar las pequeñas imperfecciones que se pueden encontrar en los pasos técnicos y también fijar pasivamente la barra fundida.



Tornillo de cierre en titanio

Anillo Seeger autoextraíble

IN PEEK

Cilindro contenedordocalcinable

PARA ANILLO SEEGER

Ot Equator

PILAR EN TITANIO +TiN



Opzione Ot Equator Seeger



CLÍNICA**Posicionamiento de la barra con sistema "elastic seeger"**

Pilar Ot Equator Profile en titanio atornillados a los implantes sobre los cuales se pondrá la barra de unión con el método "ELASTIC SEEGER".



Barra de unión de metal. En el cilindro contenedor fundido se inserta el Seeger autoextraíble en PEEK.



Utilizar el insertador para el "ELASTIC SEEGER" Y empujar el anillo elástico en PEEK hasta que llegue más allá del ecuador de la semiesfera Ot Equator



Anillo Seeger en posición y tornillo de cierre en titanio listo para atornillar.



Atornillar completamente el tornillo de bloqueo en titanio, el par recomendado es de 15Nm.



Barra atornillada. El tornillo en titanio junto al "ELASTIC SEEGER" en PEEK crea una compresión que, además de vincular pasivamente los implantes evita que se destornillen.



Trabajo acabado. Siempre se aconseja la construcción de una estructura de refuerzo en la prótesis.



En caso de un control futuro, la forma interna del anillo SEEGER en PEEK permite la auto extracción del mismo junto al tornillo de cierre en titanio.

LABORATORIO**Construcción de la barra y sobredentadura directamente sobre el modelo maestro**

Atornillar los pilares OT EQUATOR en titanio sobre las réplicas de los implantes en el modelo de yeso, sería mejor utilizar las réplicas OT EQUATOR en acero para laboratorio



Posicionar el cilindro calcinable rojo. Atornillar los tornillos de cierre en titanio con los anillos en peek sin esfuerzos.



OT EQUATOR aditamentos calcinables: para colocar sobre una barra que recibirá una sobredentadura removible. Se recomienda colar en alineación de dureza Vickers alta.



Unir los calcinables Ot equator en posición con cera o resina.



Barra fundida en posición.



Esqueleto en posición con los contenedores de cofia en acero serán parados de modo pasivo con material compuesto.



La retención de la prótesis puede observarse controlada con la selección de las cofias de diferente color y grado de retención.



Prótesis terminada

LABORATORIO**Ot Equator Seeger**

Insertión del OT Equator Seeger en el interior del anillo auto-extraíble en peek ya puesto en posición.



Como el tornillo seeger de titanio, el OT Equator seeger extrae el anillo autoextraíble en peek durante el desenroscado.



2 OT Equator filetedos para cad cam y 2 OT Equator seeger puestos en posición, en caso de divergencia (los OT Equator seeger siguen la dirección de los implantes) se sugiere el uso de contenedores Smart box.




Ver el vídeo
Seeger New en Youtube

OT BAR MULTIUSE - BARRA CALCINABLE

Superestructura fundida sin duplicar el modelo en revestimiento



La OT BAR es una barra con dos lados, un lado plano y un lado redondo que pueden ser utilizados según las exigencias. Si se quiere resiliencia se coloca con el lado plano hacia arriba, si se construye una prótesis con función rígida se coloca el lado redondo hacia arriba. Cuando la barra se coloca en un solo tramo lineal como sería el caso de dos caninos en zona incisiva se puede utilizar de forma indistinta, lado A o lado B. Si utilizamos el lado redondo hacia arriba obtendremos un movimiento oscilante y un hundimiento en la zona edéntula distal. En la otra versión obtendremos una resiliencia en la zona incisiva y un hundimiento en la zona edéntula distal. Otra alternativa es la de obtener la superestructura directamente en el modelo MAESTRO sin necesidad de duplicar el modelo con revestimiento. Con el lado plano tendremos resiliencia en el área incisiva y un hundimiento en el área distal. Otra opción es el reparto utilizando una estructura reforzada con una prótesis removible en resina que se modelará directamente sobre el modelo MAESTRO sin duplicar el modelo en revestimiento. El contenedor colado, conserva la retención para el CLIP y es calculado con una tolerancia que permite la rápida y fácil inserción y desinserción del CLIP, y por supuesto, una funcionalidad adecuada.

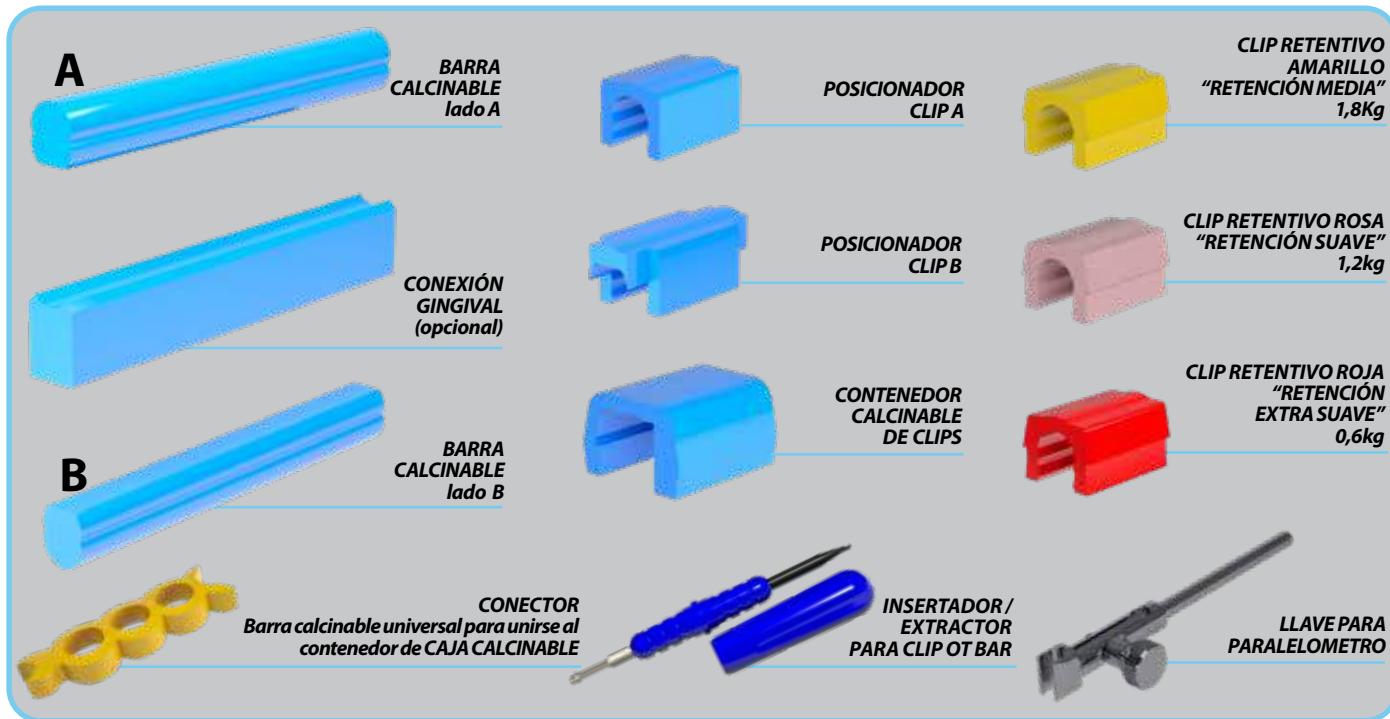


LABORATORIO

lado A

La barra versión "RÍGIDA" se utiliza para enlazar dos ataches donde se requiere un movimiento basculante anteroposterior y en caso de varios ataches donde la base protésica de un plano rígido apoya su gingiva "ATRÓFICA".

versione B

La barra montada en versión resiliente se puede aplicar en varias soluciones, sen utiliza sobre todo en casos con más de dos ataches donde la prótesis apoya en la parte gingival "HIPERTRÓFICA".

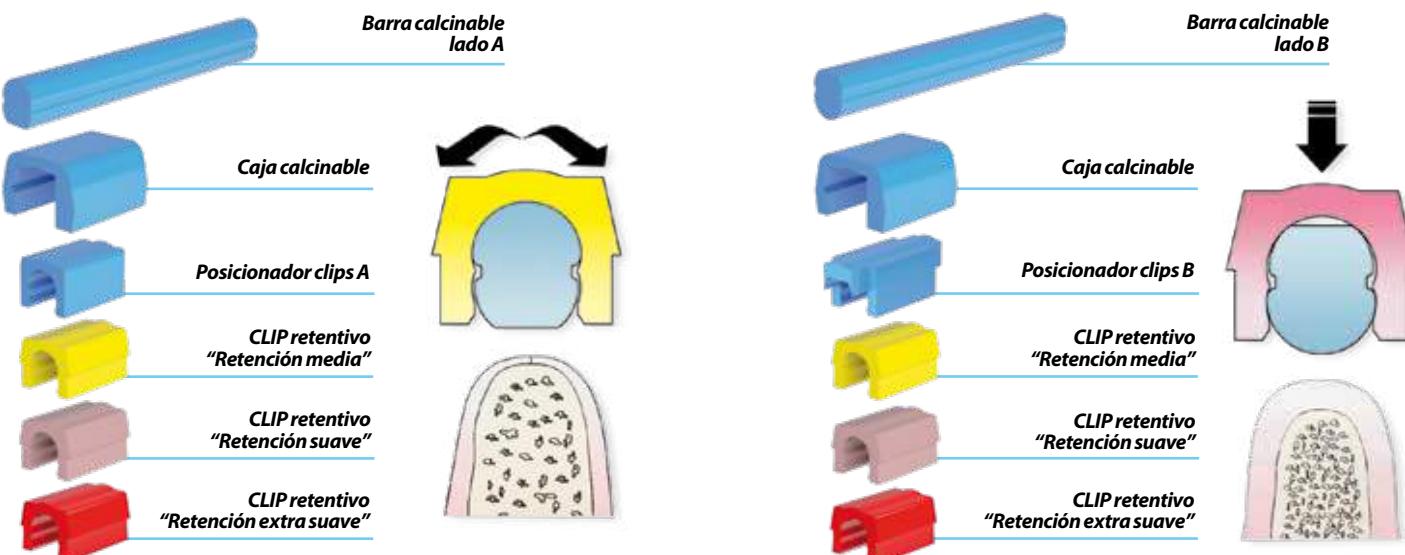

CLÍNICA



LABORATORIO *Modelado de la super estructura sobre el modelo maestro sin duplicar el modelo en revestimiento*



*Ver el video
OtBaren Youtube*

LABORATORIO *Lado A "Rígida"*



Colocar la barra del lado A con la respectiva llave de paralelometro y completar el modelo con cera o resina.

Barra fundida y terminada. No desgastar con el pulido el área retentiva de la barra.

Eliminar las áreas retentivas con cera y colocar el posicionador clips A en su sitio.

Para aislar, hay que adaptar la cinta adhesiva teflón sobre el posicionador A y sobre la barra fundida para poder colocar la caja contenedora calcinable.

Unir las cajas calcinables con resina autopolimerizante. La cinta adhesiva teflón impedirá la infiltración de la resina.

Completar el modelado con cera, para las extensiones utilizar el conector calcinable, colocar fueles y fundir.

Estructura terminada, inserción del clip retenitivo.

Prótesis terminada con estructura metálica incorporada y clips de retención insertados.

LABORATORIO *Lado B "Resiliente"*



Colocar la barra del lado B con la respectiva llave de paralelometro y completar el modelo con cera o resina.

Barra fundida y terminada. No desgastar con el pulido el área retentiva de la barra.

Eliminar las áreas retentivas con cera y colocar el posicionador clips B en su sitio.

Para aislar, adaptar la cinta adhesiva teflón sobre el posicionador B y sobre la barra fundida para poder colocar la caja contenedora calcinable.

Unir las cajas calcinables con resina autopolimerizante. La cinta adhesiva teflón impedirá la infiltración de la resina.


Completar el modelado con cera, para las extensiones utilizar el conector calcinable, colocar fueles y fundir.

Estructura terminada, inserción del clip retenitivo.

Prótesis terminada con estructura metálica incorporada y clips de retención insertados.

OT EQUATOR CALCINABLE

Pilares individuales para sobredentadura

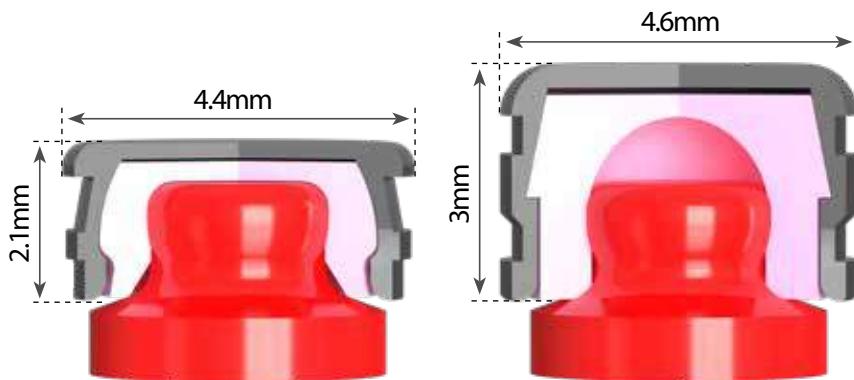

Si es necesaria mayor resiliencia en la dentadura se puede ensamblar la cofia y el contenedor metálico de un OT CAP NORMO, sobre cualquier atache OT EQUATOR. Las dentadura serán retenidas de la misma forma y la conexión será menos rígida. Solo la dimensión de el aditamento cambia.

CLÍNICA



LABORATORIO

En el caso de que los espacios reducidos lo soliciten, Los OT Equator se pueden posicionar en combinación con muñones calcinables con tornillo pasante del implante utilizado

**LABORATORIO** *OT Equator calcinable = Monocolado*

Sobre el modelo en yeso, aislar los canales con aislante para yeso-resina.



Utilizando los pivotes radiculares calcinables, rebasar los canales con resina auto curable.



Cuando es endurecida la resina en superficie, se quitan los pivotes rebasados para evitar que se bloquen dentro de el modelo y se cortan a nivel del plano radicular.



Montar los OT EQUATOR calcinables en la posición óptima con la misma llave OT CAP NORMAL para paralelometro.




OT EQUATOR en posición, completar el moldeado de cera.



Cobertura radicular fundidas con un metal de dureza 240 Vichers o superior

LABORATORIO *Construcción del refuerzo directamente sobre el modelo maestro*

Modelo en yeso: réplicas OT EQUATOR y contenedores de acero con las cofias negras integradas.

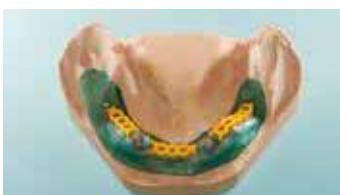

Adaptar una hoja de cera calibrada de espesor 0,5 mm y descargar los rebajes de el contenedor metálico.



Unir los componentes con resina, también sobre los contenedores de acero.



Poner los pivotes de colado a la estructura y removerla, cerciorarse que los contenedores no queden al interior y ponerla en revestimiento.



Pegar los contenedores de acero dentro de la estructura.



Usar cemento compuesto a dos pastas, anaeróbico - auto curable.



Estructura metálica con los contenedores de acero pegados en posición. Las cofias negras serán reemplazadas con aquellas definitivas de RETENCIÓN adecuada.



Prótesis terminada con el refuerzo incorporado en la resina

ESFERAS INDIVIDUALES OT CAP



**ESFERAS
INDIVIDUALES
CALCINABLES**

NORMAL

VERDE
Ø 2,5mm



MICRO

ROJO
Ø 1,8mm



PIVOTES PLÁSTICOS
No utilice la cabeza esférica

NORMAL



MICRO



En sobredentaduras, el uso de la esfera con cabeza plana, y de la cofia retentiva elástica con el interior esférico, permite que durante la masticación exista un hundimiento vertical que en algunos casos es similar al hundimiento gingival. Este fenómeno también es favorecido por la sensibilidad del nylon al actuar en un ambiente húmedo a una temperatura constante. La experiencia de muchos dentistas nos lleva a la convicción de que en un alto porcentaje de casos se obtiene una estabilidad adecuada con traumas mínimos.




ATENCIÓN

Los aditamentos pueden ser fundidos con cualquier aleación, pero es muy importante utilizar metales de elevada dureza vickers para evitar el riesgo de fractura de la esfera.
Inserción con tolerancia regulable




**ESFERAS INDIVIDUALES
TITANIO +TIN**
(Oltre 1600 Vickers)
para pegar o soldar




*Esfera
en Titánio*

NORMAL Ø 2,5mm



*Esfera
en Titánio*

MICRO Ø 1,8mm



Base de guía

CALCINABLE



*Ver el video
Ot Cap calcinable sobre
raíces en Youtube*

	Transfer NORMAL/MICRO
	Réplicas SPHERO FLEX/SPHERO BLOCK
	Contenedores de acero inoxidable para cofias PARA RESINA Y SOLDADURA
	Contenedores de cofias de titanio PARA RESINA Y SOLDADURA - EL ANODIZADO FUSCIA MEJORA EL CAMUFLAJE EN PRÓTESIS DE RESINA
	Distanciadores para contenedores NORMAL/MICRO
	Cofias blancas ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1300g / MICRO 1100g
	Cofias rosas SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 900g / MICRO 800g
	Cofias amarillas EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g
	Cofias verdes ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g
	Cofias negras No retención - laboratorio
	Llave de paralelómetro NORMAL/MICRO
	Insertador/Extractor de cofias NORMAL/MICRO - OT EQUATOR
	Cortadores TIPO MOSER
	Disco de protección

CLÍNICA

Impresión de transferencia



Coloque la transferencia sobre el balón en la boca del paciente.



Transferencia en posición, el perfil exterior garantiza una posición estable en la impresión.



Inserte los análogos dentro de las transferencias y vierta el modelo.



Modelo colado con análogos colocados.

CLÍNICA

Impresión del canal radicular




Raíces preparadas



Impregnar el perno con adhesivo



Tomar la impresión con material elastómetro




ATENCIÓN:
Con el fin de obtener un buen funcionamiento, es importante remover la resina con una fresa y crear un espacio (relieve en azul) entre la raíz y la prótesis.

LABORATORIO

ot cap esferas individuales calcinables = Monocolado



No utilizar nunca la esfera del perno!

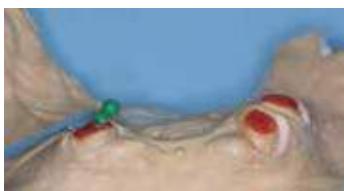

Cortar el perno al nivel del plano radicular.



Montar en paralelo la esfera individual en la posición más conveniente.



Monocolado: perno domo y esfera colados. El paralelismo de las esferas queda desfasado con respecto al eje de los pernos.

LABORATORIO

ot cap esferas individuales de titanio + tin para soldar con laser o pegar



Modelar el domo en cera alrededor de la raíz. Colocar la esfera de titanio.



Cubrir con cera solo tres lados con la esfera en paralelo.



Deslizar la esfera de la base guía calcinable antes de colocar los cueles de fundición.



Domo con base guía calcinable y cuele de fundición listo para ser revestido.



Ensamblar la esfera de titanio en la base guía utilizando el instrumento adecuado.



Esfera de titanio colocada en la base guía.



Se pega la esfera de titanio en la base guía utilizando compuestos autopolimerizante o anaeróbico.



Esfera colocada, pegada y retenida. Trabajo terminado.

CONTENEDORES CALCINABLES OT BOX



OT BOX CLASSIC
NORMAL = Verde + Amarillo
MICRO = Rojo + Amarillo




OT BOX SPECIAL
NORMAL = Verde
MICRO = Rojo



OT BOX MONO
NORMAL = Verde
MICRO = Rojo



Ver el vídeo
Ot Box en Youtube

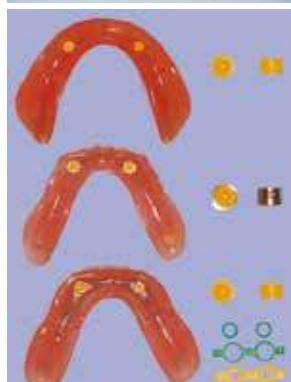

Las sobredentaduras que están hechas en resina y contienen aditamentos de cualquier marca son susceptibles a la fractura en el punto en que están insertados los aditamentos. Con una estructura de refuerzo fundida, garantizamos que el riesgo de fractura es nulo. Con el OT BOX se une y modela el refuerzo directamente sobre el modelo MAESTRO sin necesidad de ser duplicado en revestimiento. Para la fusión se puede utilizar cualquier aleación. Para el mejor desempeño de las cofias de retención, los contenedores calcinables prefabricados son construidos con una pequeña tolerancia calculada para consentir una fácil inserción de la cofia, por consecuencia cuando exista la necesidad de cambiar una cofia de retención se hará de una manera rápida y sencilla. Refuerzo metálico terminado e incorporado a la sobredentadura.



Transfer

NORMAL/MICRO



Réplicas

SPHERO FLEX/SPHERO BLOCK



Cofias blancas

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 1300g / MICRO 1100g



Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 900g / MICRO 800g



Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g



Cofias verdes

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g



Cofias negras

No retención - laboratorio



Cofias super resilientes oro

LIGERAMENTE ELÁSTICO - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g




Cofias super resilientes plata

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g



Conector

Barra moldeable universal para unión contenedores Ot Box



Insertador/Extractor de cofias

NORMAL/MICRO - OT EQUATOR

CLÍNICA

Impresión con los pernos fijos en la boca del paciente



Pernos en titanio fijos en las raíces.



Antes de la impresión posicionar los transfers sobre las esferas con el anillo direccional adecuado.



Para la impresión usar un material consistente que garantice la posición exacta de las coñas. El laboratorio insertará los análogos de esfera.



Modelo de yeso con domos esféricos y coñas.

LABORATORIO Encerado directo sobre el modelo "maestro"



"CLASSIC" pegar las 2 barras OT BOX y utilizar solo una pieza como conector.



"SPECIAL" Cortar la barra y utilizar solo la parte necesaria como contenedor.



Adaptar una hoja de cera sobre el proceso y hacer 3 orificios que servirán como topes de tejido. Colocar los anillos posicionadores en las esferas



Colocar OT BOX CLASSIC o SPECIAL en los contenedores o anillos. Completar el refuerzo utilizando los CONECTORES y unir varias piezas con resina autopolimerizante.



Completar el modelado, colocar los cuales de colado y fundir.



Colado terminado con coñas retentivas "negras" para laboratorio insertadas.



Prótesis terminada con refuerzo incorporado y coñas retentivas insertadas.



Fácil sustitución de coñas con insertador/extractor de tapones retentivos

PIVOTES DIRECTOS PARA SOBREDENTADURAS



PIVOT FLEX
en Titanio + TiN
con esfera giratoria
"autoparalelizable" Ø 2,5 mm



PIVOT BLOCK
en Titanio esfera fija
NORMAL Ø 2,5 mm
MICRO Ø 1,8 mm



3 longitudes: 10, 9, 7 mm



3 longitudes: 10, 9, 7 mm



PIVOTE OT EQUATOR
en Titanio + TiN DE BAJO PERFIL



3 longitudes: 10, 9, 7 mm



Contenedores de acero inoxidable

PARA RESINA Y SOLDADURA

Contenedores de cofias de titanio

EL ANODIZADO FUCSIA MEJORA EL CAMUFLAJE EN PRÓTESIS DE RESINA

Distanciadores para contenedores

NORMAL/MICRO

Cofias blancas

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 1300g / MICRO 1100g

Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 900g / MICRO 800g

Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g

Cofias verdes

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g

Cofias negras

No retención - laboratorio

Cofias super resilientes oro

LIGERAMENTE ELÁSTICO - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g

Cofias super resilientes plata

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g

Contenedor de cofias

ACERO INOXIDABLE

Contenedor de cofias

Titanio

Distanciador para contenedor

OT EQUATOR

Contenedor de cofias Smartbox

De posicionamiento

Cofia morada

FUERTE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 2700g

Cofias blancas transparentes

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 1800g

Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 1200g

Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: 600g

Cofias negras

SIN RETENCIÓN EXCLUSIVO PARA LABORATORIO

	Contenedores de acero inoxidable
	Contenedores de cofias de titanio
	Distanciadores para contenedores
	Cofias blancas ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1300g / MICRO 1100g
	Cofias rosas SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 900g / MICRO 800g
	Cofias amarillas EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g
	Cofias verdes ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g
	Cofias negras No retención - laboratorio
	Cofias super resilientes oro LIGERAMENTE ELÁSTICO - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g
	Cofias super resilientes plata ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g

CLÍNICA

Anillos direccionales, para esferas fijas y giratorias (flex)

Pivot Flex cementado en su sitio



Cafias de retención desalineados sin anillos direccionales



Cofias retentivas paralelas al plano oclusal gracias a la rotación correcta de los anillos direccionales

ANILLOS DIRECCIONALES con inclinación:



0°

7°

14°

CLÍNICA

Postes en titanio con esfera fija para aditamentos definitivos y temporales

Poste temporal fijado con cemento de oxifosfato.



Para quitar el poste de la raíz sujetar la esfera con las pinzas y girar con cuidado en ambas direcciones.



El poste sale fácilmente gracias a su forma lisa y cónica.



Para fijar el poste definitivamente a la raíz es mejor hacer algunas muescas con él.

CLÍNICA

Pivot block en titanio, fijación definitiva en la boca del paciente

Preparar la raíz a nivel de la mucosa y calibrar el canal radicular utilizando la fresa (Mooser) de la medida adecuada.



Llenar los canales radiculares con cementos compósitos específicos e insertar los pivotes en titanio a esfera



Pivot block micro cementados en posición, se han creado muescas retentivas sobre los pivotes en titanio para que la fijación sea definitiva



Posicionar los anillos direccionales entre las raíces y las cofias retentivas y tomar la impresión



Impresión en alginato, se pueden ver los negativos de los attaches en posición



Posicionar los discos protectores entre los anillos direccionales y las cofias retentivas



Una vez endurecida la resina, quitar la prótesis y eliminar los discos protectores, recortar el exceso de resina



Prótesis acabada

CLÍNICA

Ot Reverse3, macho de retención fijado en la boca del paciente con resina auto-curado

Se puede utilizar como retención temporal (herramienta manual), eliminando el poste en plástico. Advertencia: este sistema es solo temporales. El macho en plástico se puede fracturar o doblar con consiguiente problema de inserción consecuente.



Al fijar el atache con autocurado de la resina es importante poner siempre un disco de protección o una pequeña tira de plástico en el cuello de la esfera para evitar la infiltración de la resina.



En todas las prótesis hechas totalmente de resina, o con OT BOX LARGE. Probar y controlar las prótesis, si es necesario ampliar el espacio con un cortador, para evitar interferencias con el macho de retención



Una vez curada la resina, retire los discos protectores y recorte todo el exceso.



Ver el video
Sobredentadura directa sobre raíces en Youtobe





OT Lever, un sistema patentado para hacer rápida segura e higiénica extracción de cualquier dentadura dentadura postiza, brackets o alineadores.



Ver el vídeo
Ot Lever
en Youtube



OT Lever es eficaz en:

Prótesis total



Alineadores dentales



Prótesis combinadas




**IMPLANTES DENTALES "DESCONOCIDOS"**

Cada año se colocan varios millones de implantes dentales en todo el mundo. Por desgracia, el seguimiento de cada implante no siempre está bien garantizado. Por ello, muchos dentistas se enfrentan al problema de tener que identificar la conexión basándose en poca o ninguna información. Rhein83 ha desarrollado un protocolo sencillo y eficaz para identificar cualquier tipo de conexión de implante que ofrece varias opciones al dentista para la rehabilitación protésica, fija o removible.

**Primera opción:
CÓMO IDENTIFICAR UN IMPLANTE DENTAL**

La forma más segura y precisa de reconocer el implante desconocido es enviar un componente ya atornillado al implante en cuestión. De hecho, un pilar, tornillo de cicatrización o aditamento, siempre que tenga la rosca y la conexión intactas, será suficiente para que nuestros especialistas obtengan toda la información deseada.

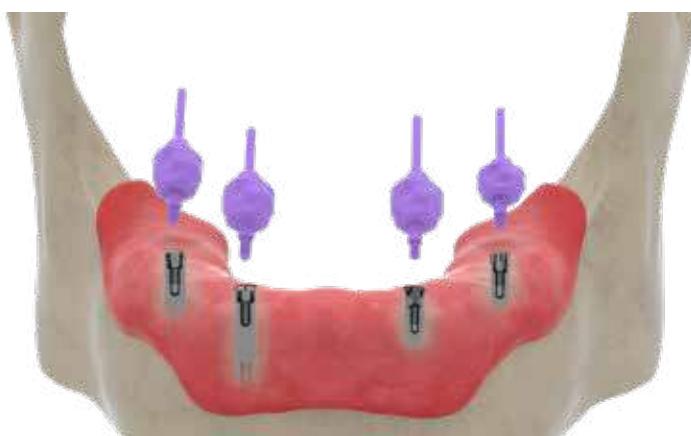
**Segunda opción:
TOMA DE IMPRESIÓN**

Utilice material de impresión (impregum con un alfiler de plástico) y proceda a la limpieza del implante si es necesario. Asegúrese de haber tomado una impresión exacta de la rosca y proceda a enviarla en sobre cerrado. **IMPRESIÓN DIGITAL:** Es posible realizar los mismos pasos con un escáner 3D enviando el archivo en formato STL a los técnicos de Rhein83.

NUEVA REHABILITACIÓN PROTÉSICA

Las soluciones Rhein83 disponibles para la clínica son múltiples. Desde prótesis removibles con Ataches de bola Sphero Block y Sphero Flex hasta el sistema OT Equator de perfil bajo. Para rehabilitaciones fijas, el protocolo OT Brdige permite optimizar cualquier tratamiento con un protocolo que estandariza las diferentes conexiones protésicas apoyándose en un único componente (pilar OT Equator). Para cada componente será necesario indicar la altura gingival deseada.





El aditamento calcinable extracoronario OT CAP, se utiliza en prótesis combinadas, esqueletos metálicos removibles, dientes naturales, raíces e implantes. En proyectos protésicos con estructura rígida que incluyan fresados y contra-ataches adecuados, funciona como un botón retentivo y estabilizador. En prótesis resiliente sin fresados funciona con hundimientos verticales tipo amortiguador gracias a la cabeza plana de la esfera y a la cofia retentiva elástica. Es posible ir regulando la retención adecuada de la cofia en base a su color y grado de retención. Según el criterio se puede utilizar la cofia de retención de nylon o la TITAN CAP. El aditamento OT CAP TECNO debe considerarse aditamento de presión. La esfera de titanio y el anillo de titanio incorporado en la cofia de nylon son fabricadas con tolerancias mecánicamente calculadas, asegurando de esta manera una excelente precisión. Por otra parte, el aditamento durante el proceso de elaboración no es afectado por ninguno de los posibles riesgos por el lijado, pulido o los fenómenos causados por el horno de ceramización, en cuanto a la esfera-aditamento, es colocada con el paralelómetro y cementada sobre el muñón de retención y el trabajo quedará terminado.

OT CAP TECNO



Sistema Ot Tecno, las esferas Normo o Micro se pueden utilizar con la misma vaina a pegar.

OT BOX MONO



Posición del anillo para ser insertado en la esfera, antes de la duplicación del modelo.

Contenedores de acero inoxidable	Barras calcinables
PARA RESINA Y SOLDADURA	NORMAL/MICRO
Contenedores de cofias de titanio	Ot Box mono
EL ANODIZADO FUCSIA MEJORA EL CAMUFLAJE EN PRÓTESIS DE RESINA	NORMAL/MICRO
Cofias blancas	Llave para paralelometro
ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1300g / MICRO 1100g	Para Ot Cap NORMAL/MICRO
Cofias rosas	Llave para paralelometro
SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 900g / MICRO 800g	Para Ot Cap Tecno NORMAL/MICRO
Cofias amarillas	Llave reguladora de retención
EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 500g / MICRO 450g	NORMAL/MICRO
Cofias verdes	Insertador /extractor de cofias
ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 350g / MICRO 200g	NORMAL/MICRO/Ot Equator
Cofias negras	En cajas metálicas y en la boca del paciente
No retención - laboratorio	
Cofias titan cap	
SUJECCIÓN EN GRAMOS: NORMAL 1500g / MICRO 1300g	



Ver el video
Ot Cap Extracoronral
en Youtube

CLÍNICA



LABORATORIO *Ot Cap calcinable*



Cortar la porción de barra que utilizaremos

Montar la esfera con la llave de paralelometro y hacer la fijación en la pared de la corona. Afinar al encerado.

Proteger la esfera con la cofia negra mientras se acaban y se brillan las coronas.

Aditamento colado. El hombro a lado de la pared de la corona dirige las cargas verticales en línea con los ataches.

LABORATORIO *Ot Cap Tecno*



Montar la extensión calcinable Ot Tecno en paralelo con la llave adecuada y completar el modelado creando un paso a lo largo de la pared de la corona.

Posicionar el atache ensamblado con la vaina con rosca (Ot Cap Micro-Normo) en la llave, aplicar compósito anaeróbico metal-metal tanto sobre la vaina como en el hueco.

Esperar que el compósito endurezca, quitar el exceso y acabar.

Una vez que el compósito haya endurecido, el atache se puede desatornillar para controlar la perfecta adhesión del mismo.

LABORATORIO *Ot box mono utilizado con la técnica de modelo duplicado con revestimiento*



Anillo posicionador en la esfera.

Modelo duplicado en revestimiento.

Contenedor de cofias OT BOX MONO colocado sobre el modelo duplicado.

Contenedor OT BOX MONO fundido y terminado albergando la cofia retentiva.




Ver el video
Ot Strategy
en Youtube

	Base estándar		Contenedor de acero inoxidable
	Base larga		Posicionador Ot Strategy
	Cofia de duplicación		Cofia por contenedor
	Blanca Estandárd - 1300g		Blanca Estandárd - 1300g
	Cofia de duplicación		Cofia por contenedor
	Rosa Suave - 900g		Rosa Suave - 900g
	Cofia de duplicación		Cofia por contenedor
	Amarillo Extra suave - 500g		Amarillo Extra suave - 500g
	Cofia de duplicación		Poste analogo
	Negra económica para procesos de laboratorio		Negra económica para procesos de laboratorio
	Insertador/extractor de cofias		
	Ot Strategy		
	Llave para paralelometro		
	Ot Strategy		



OT STRATEGY son aditamentos de precisión. Es importante colocar la esfera en paralelo, de esto depende su correcto funcionamiento. El aditamento OT STRATEGY es el único de este tipo, al tener unas líneas de apoyo debajo de la esfera (patentado) alinea automáticamente la cofia, esto es muy importante para la inserción de la prótesis y para la duración de la cofia como evita riesgos de ruptura de la esfera. La dimensión reducida de nuestro aditamento permite su aplicación en espacios reducidos, son indicados para prótesis removibles que contengan los fresados adecuados. Si no se utilizan fresados, se sugiere utilizar los accesorios STEADY.


LLAVE PARA PARALELOMETRO

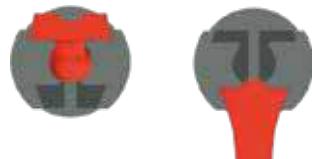

LADO A: Para el posicionamiento de la esfera
LADO B: Para el posicionamiento del steady



REFUERZO DE LA ESFERA

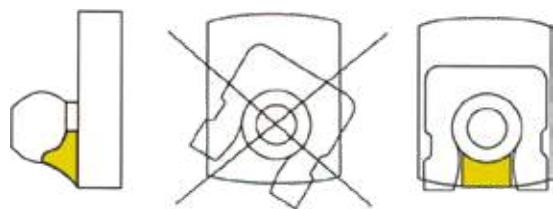

Enfriamiento equilibrado del metal fundido
Refuerzo para la esfera
Guía de alineación de la cofia

CLÍNICA



LABORATORIO *Contenedor colado para cofias retentivas*



Introduzca el husillo de bolas en la llave al final del recorrido: coloque el husillo sobre el modelo de cera y con la llave toque la escayola

Coronas terminadas con el aditamiento colado, fresado terminado y pulido.

Cofia retentiva insertada en la esfera. Encere en el modelo, esto es muy importante para mantener la cofia limpia antes de la duplicación.

Modelo duplicado, la forma de la cofia es bien reproducida.



Formato de gorro recubierto de cera. Esqueleto moldeado en cera

Colada terminada. Inserte la cofia negra de laboratorio con el insertador adecuado

Esqueleto acabado, montado en el modelo

Inserción de la cofia duplicada en sentido vertical. Prótesis terminada.

LABORATORIO *Contenedor prefabricado en acero inoxidable para cofias retentivas*



Corona y aditamento calcinable OT STRATEGY Posicionando el anillo y contenedor

Anillo posicionador en la esfera.

Contenedor de acero inoxidable colocado en el aditamiento.

Modelo duplicado en revestimiento y estructura de apoyo encerada.



1a. opción: Contenedor inoxidable soldado al esqueleto.


2a. opción: Contenedor inoxidable pegado con cemento anaeróbico.

Inserción de la cofia de retención en el contenedor inoxidable en sentido lateral.

Una vez fundida la corona con el accesorio de bola, proceda con el tapón y el recipiente prefabricado INOX. En este caso, se puede utilizar la cofia retentiva o el posicionador amarillo para duplicar el contenedor en su posición. Una vez terminado el trabajo, se realiza la unión con el esqueleto mediante soldadura o pegado.

OT STRATEGY + OPTIONAL STEADY

Attacco verticale calcinabile MICRO

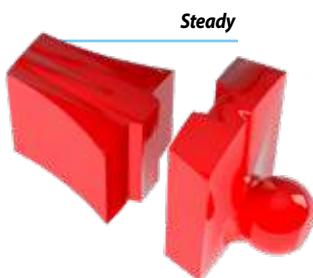

LABORATORIO técnica con base estándar + steady




Insertar el componente STEADY en la llave de paralelometro (lado B) posicionarlo y acortarlo si es necesario.

Posicionar el macho esférico en la llave (lado A) y pegarlo al componente STEADY en la posición óptima.

Terminada la fusión, colocar la cofia de retención sobre la esfera y así aliviar las áreas retenativas.

Optional = STEADY




Modelo duplicado en revestimiento.

Esqueleto modelado.

Trabajo terminado.

LABORATORIO técnica con base larga + steady




EL

STEADY calcinable es un soporte de forma cónica definido como OPCIONAL, puede ser utilizado solo en algunos casos, particularmente donde no existen fresados. Es con aumento en línea y utilizado con la idea de personalizar las prótesis, se puede utilizar con la base STRATEGY: ESTÁNDAR Y LARGA, esto nos ofrece varias soluciones técnicas.

Insertar el componente STEADY en la llave de paralelometro (lado B) y posicionarlo, acortar si es necesario.

Posicionar el macho esférico en la llave (lado A) y pegarlo al componente STEADY en la posición mejor.

Corona y aditamento terminados, el STEADY es rebajado y adaptado en base a las necesidades.

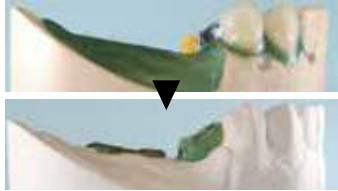

Corona y STEADY aliviados y bloqueados para ser duplicados incluyendo la cofia retenitiva colocada en la esfera.

Esqueleto metálico insertado en el modelo

Trabajo terminado.

En caso de que no existan fresados de apoyo, el STEADY funciona como "contraaditamiento". En caso de desdentados unilaterales, el STEADY evita la tracción distal y el desplazamiento lateral.

CLÍNICA







CLÍNICA

Ot Strategy

LABORATORIO

Ot Strategy, proyecto protésico





CLÍNICA

Ot Cap

LABORATORIO

Ot Cap, proyecto protésico (arcada inferior y superior)

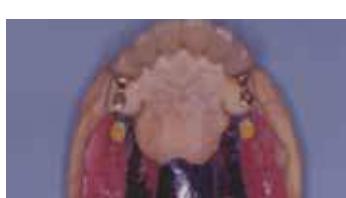

OT UNILATERAL

Aditamento A Retención combinada para prótesis monolateral



EL OT Unilateral es un aditamento libre en silla de montar para soluciones protésicas unilaterales, muy fácil de trabajar para el técnico. Los pacientes lo sienten mucho más cómodo y seguro como una solución protésica fija. Con una buena combinación entre las estructuras y las cofias retentivas, las prótesis adherirán perfectamente a los tejidos gingivales y proporcionarán buena estabilidad especialmente cuando son cargadas por las fuerzas masticatorias, lo cual incrementará la compresión de la silla de montar sobre los tejidos, evitando presión y traumas de los principales attaches.



COFIAS RETENTIVAS OT CAP



Cofias blancas

ESTÁNDAR - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 1300g / MICRO 1100g



Cofias rosas

SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 900g / MICRO 800g



Cofias amarillas

EXTRA SUAVE - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 500g / MICRO 450g



Cofias verdes

ELÁSTICOS - SUJECCIÓN EN GRAMOS:
NORMAL 350g / MICRO 200g



Cofias negras

No retención - laboratorio



Insertador/extractor de cofias NORMAL/MICRO/Ot Equator

COFIAS RETENTIVAS OT STRATEGY



Cofia de duplicación

Blanca Estandárd - 1300g



Cofia de duplicación

Rosa Suave - 900g




Cofia de duplicación

Amarillo Extra suave - 500g



Cofia de duplicación

Negra económica
para procesos de
laboratorio



Insertador/extractor de cofias

Ot Strategy




Llave para paralelometro

Ot Strategy

LABORATORIO

Especificaciones técnicas: esferas con techo plano ayudan también a distribuir la carga de la masticación sobre la encía
retención y resilencia son controladas con un surtido de cofias retentivas

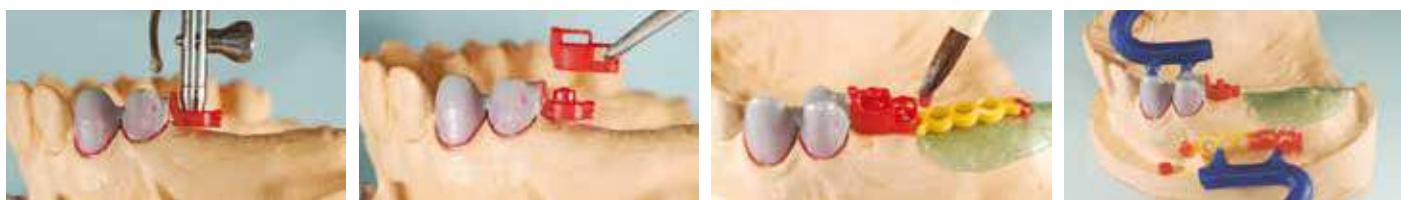LABORATORIO Silla monolateral: montaje del atache y sobrestructura en una fase

Posicionar la barra OT UNILATERAL utilizando la llave OT CAP empezando por el análisis del plano masticatorio y conectarla a la última corona modelada en cera.

Insertar el anillo posicionador sobre la esfera OT CAP micro. Posicionar el componente UNI-BOX calcinable, el anillo posicionador garantizará la estabilidad.

Conectar distalmente un conector al componente UNI-BOX con resina o cianoacrilato teniendo cuidado de no invadir el interior dell'UNI-BOX

Quitar el anillo posicionador de la esfera OT CAP y poner pivotes a las dos estructuras.




La fusión contemporánea es una de las peculiaridades del OT UNILATERAL

OT UNILATERAL y UNI-BOX fundidos, arenar con atención para no desgastar las esferas y las paredes de la barra, insertar las cofias negras para las fases de prueba y de acabado de la prótesis.

Prueba en cera, la silla gingival debe extenderse bien adherida a la encía para asegurar la estabilidad y el funcionamiento

Trabajo acabado, en el componente UNI-BOX fundido, se insertan las cofias retentivas definitivas con grados de retención adecuados.

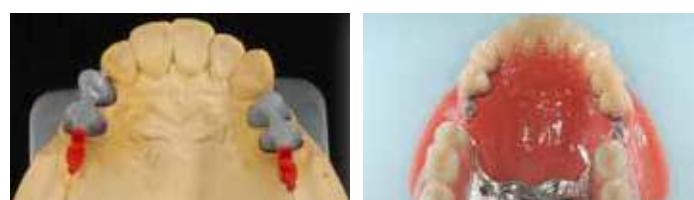LABORATORIO Silla bilateral: función resiliente y estabilidad sin fresajes

Posicionar la barra OT UNILATERAL utilizando la llave OT CAP micro empezando por el análisis del plano masticatorio y conectarla a la última corona modelada en cera.

Trabajo acabado, en el componente UNI-BOX fundido, se insertan las cofias ot cap y ot strategy definitivas con grados de retención adecuados.

LABORATORIO Barra sobre implantes: extensiones distales y función combinada

Tras la inserción de los anclajes para la construcción de la barra, posicionar la barra OT UNILATERAL utilizando la llave OT CAP empezando por el análisis del plano masticatorio. Conectarla distalmente a la barra modelada.


Barra colada, gracias a la función combinada del OT UNILATERAL, se garantiza una mayor estabilidad a la prótesis sin sobrecargar los implantes.

OT VERTICAL

Aditamento extracoronario calcinable



Llave de paralelómetro





Macho calcinable



Opcional Steady



El atache OT VERTICAL y el clip retentivo tienen una altura de 5 mm y se pueden acortar hasta el signo indicativo obteniendo una altura de 3.5 mm. El mismo signo indicativo también será útil para el dentista si, en futuro, tendrá que cambiar el clip en la boca del paciente.

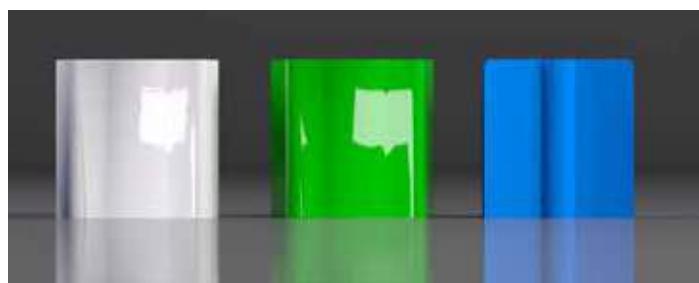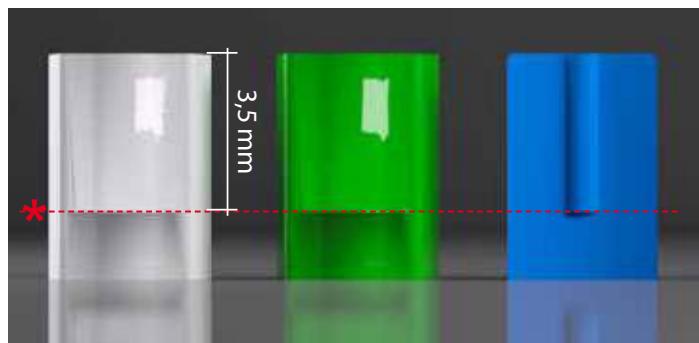

Los ataches Ot Vertical y los clips retentivos se pueden bajar en altura para evitar inconvenientes, no recomendamos acortarlos más allá del signo indicativo * de 3,5 mm.



Ver el video
Ot Vertical
en Youtube

LABORATORIO / Montaje macho calcinable individual


Llave para el paralelómetro: insertar el enchufe en el agujero del atache, girar algunas veces para obtener el sello correcto y poder llevarlo cómodamente después del la fijación del atache en la cera.



Completato il montaggio e la modellatura in cera chiudere il foro con della cera e creare un fresaggio linguale, procedere alla pernatura del manufatto.



Coronas con attaches colados y fresado acabado.



Clip retentivo insertado en el macho cilíndrico. Modelo encerado (tener cuidado de no ensuciar de cera la cofia antes de la duplicación).



Modelo duplicado en revestimiento con la reproducción del formato del clip



Mascarilla colada y arenada



Trabajo acabado, clip retentivo verde insertado en el esqueleto.



Trabajo acabado

LABORATORIO / Montaje macho calcinable + steady


Llave para el paralelómetro: insertar el enchufe en el agujero del Steady adaptado para seguir el perfil mucoso, girar para quitar la llave después de fijarlo..



Posicionar el macho Ot Vertical pegandolo a nivel lingual al Steady y completar con el cerado.



Coronas con atache colado, el Steady y el Vertical se han adaptado al perfil de la mucosa.



Clip retentivo insertado sobre el macho cilíndrico. Modelo descargado con cera (atención a no sucinar de cera la cofia entes de la duplicaciòn).



Modelo duplicado en revestimiento con la reproducción del formato del Steady y del clip.



Mascarilla modelada. Rvestir con la cera la porciòn Steady para conseguir un guàa a la inserciòn y estabilidad una vez colada.



Mascarilla insertada sobre el Steady




Mascarilla sobre el modelo. La estabilidad es garantida tambièn sin fresado, gracias al Steady

PIN DE CERRADURA OT LOCK

Con mecanismo intercambiable




PIN DE CERRADURA EN TITANIO

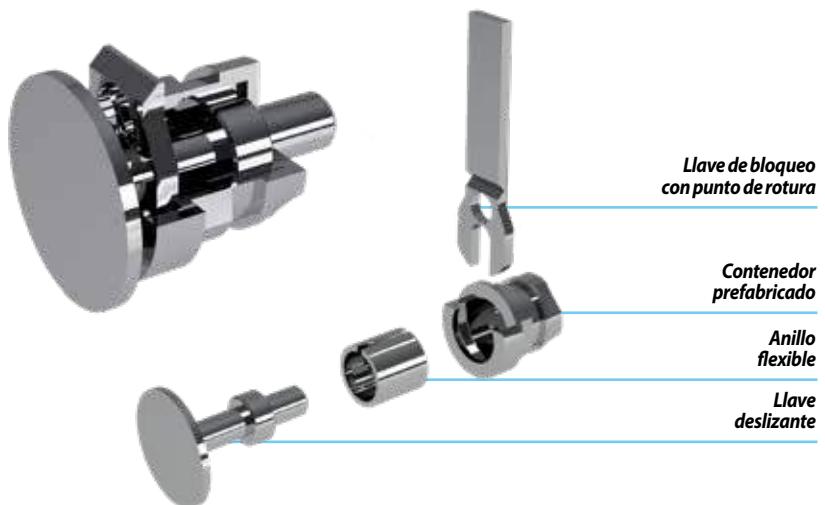


PIN DE CERRADURA EN TITANIO AJUSTABLE


Sistema de anillos espaciadores para posicionar la llave siguiendo la forma de la dentadura

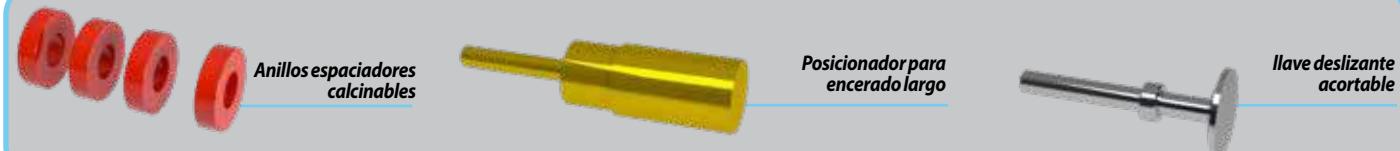

LABORATORIO / Pin de cerradura en titanio

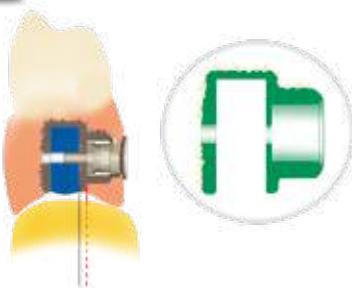

Llave de cerradura en posición regulada normalmente

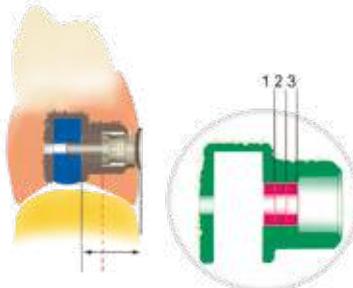

Llave de cerradura posicionada utilizando anillos espaciadores para seguir la forma de la dentadura



Insertar el PIN Cerámico



Barra colada pulida y terminada



Insertar el conformador del contenedor dentro del orificio y los elementos en su lugar. Asegurarse de no pasar la marca de "stop" cuando se aplica la resina.



Fabricar la super estructura de la resina hasta el tope. Quitar el conformador del contenedor y colar.



Remover el contenedor moldeado de la estructura calcinada.



El contenedor circular está hecho a la medida para insertar y pegar el contenedor prefabricado.



Modelar la estructura con resina, cubrir el espaciador cerámico y la parte del contenedor moldeado.



Insertar la llave de cerradura, dentro de la guía de retención y asegurarla con resina.



Doblar y romper la extensión opuesta. Pulir y terminar.



Aplicación del material compósito autocurable para parar la llave de bloque e insertar el perno deslizante en el mismo agujero.



Pulir y terminar.



Trabajo terminado. A la derecha se encuentra el pin de cerradura de titanio y a la izquierda el pin de cerradura colado, ambos tienen la misma función.

Concave RECONSTRUCTIVE Sphere

OT EQUATOR

 $\varnothing 1,8$  $\varnothing 2,25$  $\varnothing 2,5$  $\varnothing 2,5$
OT Equator

PARA RECONSTRUIR
CUALQUIER ADITAMIENTO
ESFÉRICO DEL MERCADO



Ver el vídeo
Esferas reconstructivas
en Youtube

Los aditamentos dentales, como la mayoría de los mecanismos, están sujetos al desgaste. En muchos casos el aditamento comienza a desgastarse en un breve período de tiempo, cuando la situación general, tanto de la boca como de la prótesis, aún está en condiciones ideales. El paciente se queja de la inestabilidad de la parte móvil de la prótesis y en algunos casos la única solución es rehacer la prótesis. Rhein83 produce esferas para renovar o modificar estos aditamentos que volverán a dar de nuevo estabilidad a la prótesis en una única sesión, resolviendo un serio problema, en muchos casos tanto para el paciente como para el dentista". Así se resolverá el problema sin tener que recurrir a nuevas prótesis. La técnica para aplicar estas pequeñas esferas es una simple operación gracias a los instrumentos que se suministran con las esferas y que permiten al dentista tratar, adaptar y colocar las esferas en su posición exacta en la boca, una operación que de lo contrario sería complicada debido a las dimensiones extremadamente pequeñas de las esferas. El color dorado de estas esferas se atribuye a su baño de TiN que le proporciona una superficie extremadamente dura y resistente al desgaste (más de 1600 Vickers).

ESFERA HUECA


Disponible en 3 tamaños:

$\varnothing A$	$\varnothing B$
2,5 mm	1,9 mm
2,25 mm	1,55 mm
1,8 mm	1,4 mm

OT EQUATOR

$\varnothing A$	$\varnothing B$
2,5 mm	2,1 mm

- A - Soporte de la esfera
- B - Sujeción de la esfera
- C - Sujeción de la banda
- D - Espátula para insertar el cemento dentro de la esfera.



Viendo el éxito que tienen los aditamentos esféricos es indispensable que tengan una larga vida funcional. En los casos de prótesis donde las esferas se han comenzado a desgastar, es posible en las primeras fases utilizar copias de elasticidad más ajustada (DR8), para restaurar la retención. Después, con las ESFERAS HUECAS se restaura el tamaño original así que quede cubierta de titanio con baño de TiN y tenga un índice Vickers de más de 1600, lo que asegura un funcionamiento sin problemas en el futuro. Otras aplicaciones útiles pueden ser: La posibilidad de transformar aditamentos de otros sistemas, que ya están colocados en boca pero que tienen esferas de diámetro pequeño, en aditamientos con grandes esferas para obtener una mayor retención. Transformar aditamentos de sobredentadura que tienen otro diseño, por ejemplo tipo "O Ring", postes cónicos o de otra forma, en attaches con una retención esférica.

CLÍNICA

Restauración de un atache esférico desgastado



Con la herramienta de plástico (lado A), tomar la esfera hueca ,intentar ponerla sobre la esfera desgastada.



En el caso de que la esfera hueca no entre en la esfera consumada, utilizando una broca cilíndrica (diamante o tungsteno) reducir el diámetro en la medida necesaria para ensertar la esfera hueca en la posición



Comprobar el correcto posicionamiento de la esfera hueca en el poste acabado y desengrasar las 2 partes.



También puede afinar la superficie del metal con la herramienta de un lado C, mediante la inserción de una tira en los cortes adecuados, insertar y girar con la mano.



Utilizar un cemento compuesto de dos componentes y colocar una pequeña cantidad dentro de la esfera.



Colocar la esfera hueca sobre el poste y esperar el endurecimiento de el cemento compuesto.



Una vez endurecido, eliminar el exceso de compuesto.



Terminado el trabajo, la cofia se puede remplazar si es necesario.

ESFERA SÓLIDA RECONSTRUCTIVA


Titanio + baño de TiN



PARA RECONSTRUIR
CUALQUIER
ADITAMENTO CÓNCAVO
EN EL MERCADO COMO:
ERA, CEKA, ETC.



Las ESFERAS DE RECONSTRUCCIÓN SÓLIDAS pueden colocarse en todo tipo de aditamentos huecos o de aquellos con un anillo, por ejemplo: ERA-CEKA, etc. Existen varios tipos y formas en el mercado y se utilizan en muchas clases de prótesis, en sobredentaduras, en implantes y raíces, en estructuras y prótesis combinadas. Si se empiezan a desgastar no es fácil reactivarlos. Las ESFERAS DE RECONSTRUCCIÓN SÓLIDA ofrecen una alternativa válida y permiten transformar un atache "CÓNCAVO" en un Micro OT CAP, directamente en la boca del paciente. Además garantizan un mecanismo funcional de larga duración, gracias al baño de TiN. Las esferas sólidas no se desgastan y el mantenimiento futuro se limita al cambio de las cofias de retención elástica, recomendado cada 12 meses.

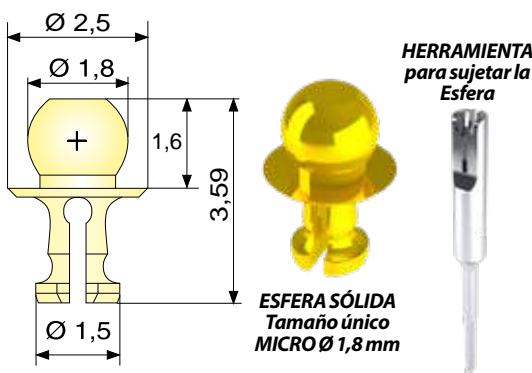

Ot Cem es un cemento compósito micro-híbrido autofoto polimerizable. El cemento se ha diseñado para pegar en manera definitiva metal-metal en el uso de ataches o para soluciones protésicas implantares. Se recomienda para los siguientes productos: OT CAP TECNO, ESFERA HUECA, ESFERA SÓLIDA, COPING COVER, ecc.

CLÍNICA

La restauración de un atache a forma de anillo



Atache antiguo desgastado.



Con la herramienta adecuada se coloca la esfera sólida con el compuesto de dos componentes y se espera el endurecimiento.



El atache se ha convertido en un OT CAP MICRO directamente en la boca del paciente.

CLÍNICA

Restaurar una barra fresada desgastada



Sobre una barra sin ataches con pérdida de fricción, crear un agujero en la pared del diámetro del poste esférico (1,6mm).



Colocar el compuesto en el vástago de la esfera sólida, con la herramienta en posición y esperar el curado.



Esfera sólida pegada en su sitio. Ahora se establece la cofia Ot Strategy en la prótesis, se obtiene estabilidad y retención.

CLÍNICA

Recuperación de los ataches en titanio cementados y fracturados



Paciente con ataches en titanio cementado sobre implantes desconocidos, que están libres de estrías en la cabeza del atache.



Si el dentista no puede hacer una sustitución completa, restaurar la retención pegando las esferas sólidas en la cavidad.



Prótesis ya existentes estabilizada gracias a la retención restaurada en la clínica.



SERVICIOS DIRECTOS

Un servicio telefónico está disponible durante las horas de oficina para responder a preguntas técnicas e información diversa.

Tel. +39 051 244510 - +39 051 244396 - Fax +39 051 245238

Rhein83 página web
www.rhein83.com

Informaciones generales
info@rhein83.com

pedidos extranjeros
international.orders@rhein83.it

Soporte técnico
support@rhein83.com

Oficina de Marketing
direzione@rhein83.it



RHEIN 83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

